

## LOTTO 1 – FILTRI PER CIRCUITI

### SUB LOTTO 1.1

#### FILTRO PER ANESTESIA ANTIBATTERICO-ANTIVIRALE PER CIRCUITI RESPIRATORI CON PRESA PER CO2 FILTRAZIONE ELETTROSTATICA

SUB LOTTO 1.1.1 filtro con spazio moro ridotto circa 10ml, neonatale

SUB LOTTO 1.1.2 filtro con spazio moro ridotto circa 25ml, pediatrico

SUB LOTTO 1.1.3 filtro con spazio moro ridotto circa 50ml, adulti

Hanno presentato offerta e campionatura le ditte AIR LIQUID, COVIDIEN, FIMAS, MEDISIZE, SANIC, TELEFLEX.

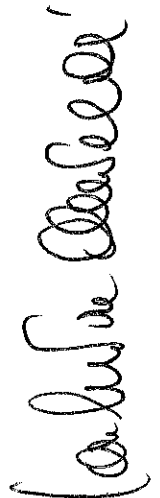
La ditta **AIR LIQUID** presenta dispositivi **NON RISPONDENTI** a quanto richiesto nel capitolato per i seguenti motivi:

- temperatura resa non dichiarata
- efficacia di rimozione 0,025-0,027 ( valore richiesto inferiore o uguale a 0,02 micron)
- non dichiarata resistenza del filtro ossia i cm H2O per 60 litri/minuto

La ditta **COVIDIEN** campiona dispositivi **NON RISPONDENTI** al richiesto in quanto la resistenza del filtro risulta essere 2,7 cm H2O a 60 litri/minuto anziché inferiore o uguale a 2,5cm H2O.

Analogamente la ditta **FIMAS** offre dispositivi **NON RISPONDENTI** per le seguenti motivazioni:

- efficacia di rimozione (la ditta dichiara 0,2 micron a monte di circa 0,02 micron richiesti)
- non viene riportata le resistenza riferita a 60 litri/minuto bensì a 11 litri/minuto



1



Rosanna Popstruone  
FIREnze

La ditta **MEDISIZE** offre dispositivi **NON RISPONDENTI** per le seguenti motivazioni:

- non vengono dichiarate né la temperatura resa né la capacità di umidificazione
- non viene specificata l'efficacia di rimozione

la ditta **SANIC** campiona dispositivi **NON RISPONDENTI** in quanto non vengono dichiarate né la temperatura resa né l'efficacia di rimozione né la resistenza del filtro.

La ditta **TELEFLEX** campiona dispositivi **NON RISPONDENTI** al richiesto per le seguenti motivazioni:

- umidificazione e temperatura resa non dichiarata
- non dichiarata resistenza del filtro al flusso di 60 litri /minuto
- efficacia di rimozione 0,027 (richiesto inferiore o uguale a 0,02 micron)
- 

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

#### SUB LOTTO 1.2

**FILTRO HME PER RIANIMAZIONE ANTIBATTERICO-ANTIVIRALE PER CIRCUITI RESPIRATORI CON PRESA PER CO2 FILTRAZIONE ELETTROSTATICA/MECCANICA**

SUB LOTTO 1.2.1 filtro con spazio moro ridotto circa 10ml, neonatale

SUB LOTTO 1.2.2 filtro con spazio moro ridotto circa 25ml, pediatrico

SUB LOTTO 1.2.3 filtro con spazio moro ridotto circa 100ml, adulti

Presentano offerta e campionatura le ditte COVIDIEN, FIMAS, MEDISIZE, TELEFLEX.

La ditta **COVIDIEN** campiona dispositivi **NON RISPONDENTI** al richiesto in quanto presentano valori superiori di resistenza rispetto a quelli indicati.

*per* *SA* *SA* *R.A.* *Cl.*

La ditta **FIMAS** offre dispositivi **NON RISPONDENTI** per le seguenti motivazioni:

- efficacia di rimozione (la ditta dichiara 0,2 micron a monte di circa 0,02 micron richiesti)
- non viene riportata le resistenza riferita a 60 litri/minuto bensì a 11 litri/minuto
- 

La ditta **MEDISIZE** non offre il dispositivo del SUB LOTTO 1.2.1.

Risulta **NON RISPONDENTE** in quanto non viene specificata l'efficacia di rimozione.

La ditta **TELEFLEX** campiona dispositivi **NON RISPONDENTI** al richiesto per le seguenti motivazioni:

- temperatura resa non dichiarata
- resistenza del filtro al flusso non riferita a 60 litri /minuto per 1.2.1, mentre per 1.2.2 non rientra nei valori richiesti da capitolato
- efficacia di rimozione 0,027 micron (richiesto inferiore o uguale a 0,02 micron) per 1.2.2 e 1.2.3, non specificata per 1.2.1

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

## **LOTTO 2 – CIRCUITI RESPIRATORI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

### **SUB LOTTO 2.1**

CIRCUITI RESPIRATORI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE

SUB LOTTO 2.1.1 CIRCUITO ANESTESIA ADULTI CM160 CIRCA CON RACCOGLI CONDENZA

SUB LOTTO 2.1.2 CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO CM 120 CIRCA CON RACCOGLI CONDENZA

  
 R.A. *eh*

La ditta **DEAS** offre dispositivi dal sub lotto 2.1.1.1 a 2.1.1.7

I dispositivi campionati sono **rispondenti al richiesto**. Ed il punteggio assegnato è il seguente:

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima resistenza allo schiacciamento)	12
FLESSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima flessibilità)	6
DISTENSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della maggiore distensibilità)	6
TENUTA DELLE CONNESSIONI(facilità di connessione, assenza perdite nel momento della connessione, mancanza di resistenza alla deconnessione manuale)	12
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17
TOTALE	70 PUNTI

**SUB LOTTO 2.2**

**TUBO RACCORDATO CON PALLONE PER VENTILAZIONE MANUALE DA CONNETTERE A VENTILATORE MECCANICO DI ANESTESIA**

SUB LOTTO 2.2.1 tubo adulti cm 60 circa raccordato con pallone da 2 litri

SUB LOTTO 2.2.2 tubo pediatrico cm 60 circa raccordato con pallone da 1 litri

SUB LOTTO 2.2.3 tubo neonatale cm 60 circa raccordato con pallone da 0.5 litri

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS

*pmc*

*R.A.*  
*SA* *Ch*

La ditta **COVIDIEN** non offre i dispositivi del sub lotto 2.2.3.

Campionando dispositivi rispondenti al richiesto e rientrando comunque nell'80% delle voci del sublotto è da ritenersi **IDONEA**.

Le ditte **ALFAMED** e **DEAS** offrono dispositivi **RISPONDIENTIAI** richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

	ALFAMED	DEAS	COVIDIEN
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima resistenza allo schiacciamento)	12	12	12
FLESSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima flessibilità)	6	6	6
DISTENSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della maggiore distensibilità)	6	6	6
TENUTA DELLE CONNESSIONI(facilità di connessione, assenza perdite nel momento della connessione, mancanza di resistenza alla deconnessione manuale)	3	12	12
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	17	17	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	4,25	17	17
TOTALE	48,25 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI

La ditta **ALFAMED** non raggiunge la sufficienza nei parametri tenuta delle connessioni e qualità costruttiva legata ad aspetti di sicurezza per il paziente per la troppo facile deconnessione del pallone dal tubo.

### SUB LOTTO 2.3

CIRCUITO MONOUSO PER VENTILATORE DI RIANIMAZIONE DA TRASPORTO

SUB LOTTO 2.3.1 ADULTI

*dm* *pk* *de R.A.* *eh*

SUB LOTTO 2.3.2 PEDIATRICO

SUB LOTTO 2.3.3 NEONATALE

NESSUNA DITTA PRESENTA OFFERTA

SUB LOTTO 2.4

**CIRCUITO PLURIUSO PER VENTILATORE DI RIANIMAZIONE DA TRASPORTO**

SUB LOTTO 2.4.1 ADULTI

SUB LOTTO 2.4.2 PEDIATRICO

SUB LOTTO 2.4.3 NEONATALE

NESSUNA DITTA PRESENTA OFFERTA

SUB LOTTO 2.5

**CIRCUITO DI ANESTESIA PER RMN**

SUB LOTTO 2.5.1 LUNGHEZZA CM350 CIRCA PER PAZIENTI ADULTI

SUB LOTTO 2.5.2 LUNGHEZZA CM 300 PER PAZIENTI NEONATALI E PEDIATRICI

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS.

La ditta **COVIDIEN** offre dispositivi rispondenti al richiesto.

La ditta **FIMAS** campiona per 2.5.2 un dispositivo contenente ftalati senza che si evinca l'assenza di rilascio.

Per il 2.5.1 campiona dispositivo idoneo rientrando pertanto nell'80% delle voci del sub lotto.

*per fax S.R.A. Chi*

Le ditte **ALFAMED** e **DEAS** offrono dispositivi **IDONEI**.

i punteggi assegnati sono i seguenti:

	ALFAMED	DEAS	COVIDIEN	FIMAS
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima resistenza allo schiacciamento)	12	12	12	12
FLESSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima flessibilità)	6	6	6	6
DISTENSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della maggiore distensibilità)	6	6	6	6
TENUTA DELLE CONNESSIONI(facilità di connessione, assenza perdite nel momento della connessione, mancanza di resistenza alla deconnessione manuale)	12	12	12	12
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	17	17	17	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17	17	17	17
	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI

SUB LOTTO N2.6

**PALLONE PER CIRCUITO**

SUB LOTTO 2.6.1 capacità 0,5 litri

SUB LOTTO 2.6.2 capacità 1 litro

SUB LOTTO 2.6.3 capacità 2 litri

SUB LOTTO 2.6.4 capacità 3 litri

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: R.A. el  
 - Middle right: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]

Presentanoofferta le ditte AIR LIQUID,ALFAMED, AMBU, COVIDIEN , DEAS, DIEMME, FIMAS, HAROL, MEDISIZE, MEDIVAL, SANIC, TELEFLEX.

La ditta **AIR LIQUID** offre tutte le voci del sub lotto.

Dall'etichetta si evince la presenza di ftalati, tuttavia poiché non compare la dichiarazione di assenza di rilascio è da ritenersi **NON IDONEA**.

L'etichetta risulta, inoltre, priva delle informazioni richieste dalla normativa vigente.

La ditte**ALFAMED, AMBU, MEDISIZE** offrono tutte le voci del sub lotto.

I dispositivi offerti sono privi di raccordo flessibile e pertanto non rispondenti al richiesto.

Si evince , inoltre, la presenza di ftalati senza che vi sia la dichiarazione di assenza di rilascio.

Sono da ritenersi, pertanto, **NON IDONEE**.

Le ditte**COVIDIEN, DEAS, DIEMME, HAROL, MEDIVAL, SANIC** offrono tutte le voci del sub lotto.

I dispositivi non presentano raccordo flessibile e pertanto sono da ritenersi **NON IDONEI**.

La ditta **TELEFLEX** offre tutte le voci del sub lotto.

I dispositivi non sono dotati di raccordo flessibile e pertanto sono da ritenersi **NON IDONEI**.

Viene rilevata, inoltre, incongruenza tra documentazione tecnica ed etichetta: sulla documentazione viene riportata l'assenza di ftalati mentre in etichetta compare il simbolo degli stessi senza che vi sia la dichiarazione di assenza di rilascio.

La ditta **FIMAS** offre tutte le voci del sublotto.

*per AA of R.A. cr.*



SUB LOTTO 2.1.3 CIRCUITO ANESTESIA NEONATALE CM 100 CIRCA CON RACCORDO CURVO PER TUBO ENDOTRACHEALE

SUB LOTTO 2.1.4 CIRCUITO ANESTESIA ADULTI CM 200 CIRCA

SUB LOTTO 2.1.5 CIRCUITO ANESTESIA ADULTI CM 150 CIRCA

SUB LOTTO 2.1.6 CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO CM 120 CIRCA

SUB LOTTO 2.1.7 CIRCUITO ANESTESIA PEDIATRICO CM 200 CIRCA

SUB LOTTO 2.1.8 CIRCUITO MONOTUBO ADULTI CM 100 CIRCA CON VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA, 22FLEX, PROVVISIO DI RACCORDO PER USO UMIDIFICATORE KENDALL 15900

Presentano offerta le seguenti ditte: ALFAMED, DEAS, COVIDIEN, FIMAS, MEDISIZE, TELEFLEX.

La ditta **ALFAMED** offre dispositivi compresi dal sub lotto 2.1.1 a 2.1.7

Si ritiene incompleta la scheda tecnica presentata: non si evince infatti la presenza del raccogli condensa là dove richiesto e pertanto è da ritenersi **NON IDONEA**.

La ditta **COVIDIEN** non offre dispositivi 2.1.3 e 2.1.8. I dispositivi offerti contengono ftalati e non c'è evidenza dell'assenza del rilascio pertanto sono da ritenersi **NON IDONEI**.

La ditta **FIMAS** non offre i dispositivi dei sub lotti 2.1.2 e 2.1.8.

I dispositivi offerti al 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 contengono ftalati e non si evince l'assenza del rilascio pertanto sono da ritenersi **NON IDONEI**.

La ditta **MEDISIZE** non offre i dispositivi del sub lotto 2.1.2 e 2.1.8. In etichetta compare il simbolo degli ftalati e non si evince l'assenza del rilascio pertanto è da ritenersi **NON IDONEA**.

La ditta **TELEFLEX** non offre i dispositivi dei sub lotti 2.1.3, 2.1.7 e 2.1.8

**Presentando solamente 5 voci su 8 non rientra nell'80% della rispondenza delle voci del sub lotto e pertanto è da ritenersi NON IDONEA.**

*dm* *SA-R.A.* *eh*

Il dispositivo presentato per 2.6.1 risulta NON RISPONDENTE in quanto viene campionato e riportato su documentazione tecnica pallone da 1 litro, il raccordo, inoltre, non è flessibile.

Risulta **RISPONDENTE** per i **rimanenti sub lottied** il punteggio assegnato è il seguente:

QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della commissione tecnica)	24
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	23
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	23
	<b>70 PUNTI</b>

**SUB LOTTO 2.7**

UNITA' RESPIRATORIA MANUALE

SUB LOTTO 2.7.1 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt0,5 CON TUBO cm150

SUB LOTTO 2.7.2 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt0,5 CON TUBO cm200

SUB LOTTO 2.7.3 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt0,5 CON TUBO cm300

SUB LOTTO 2.7.4 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt 1 CON TUBO cm150

SUB LOTTO 2.7.5 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt 1 CON TUBO cm200

SUB LOTTO 2.7.6 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt 1 CON TUBO cm300

SUB LOTTO 2.7.7 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt 2 CON TUBO cm150

SUB LOTTO 2.7.8 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt 2 CON TUBO cm200

SUB LOTTO 2.7.9 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE CON PALLONE DA lt 2 CON TUBO cm300

*fu* *A* *P* *R.A.* *er.*

Presentano offerta le seguenti ditte: AMBU, COVIDIEN, DEAS, TELEFLEX.

La ditta **AMBU** offre tutte le voci del sub lotto.

Risulta tuttavia **NON IDONEA** in quanto presenta un dispositivo con caratteristiche non rispondenti al richiesto nello specifico pallone di Ambu.

La ditta **COVIDIEN** offre tutte le voci del sub lotto.

Risulta tuttavia **NON IDONEA** in quanto in etichetta si evince la presenza di fralati senza che nella documentazione tecnica vi sia la dichiarazione di assenza di rilascio.

Dalla documentazione tecnica, inoltre, non si evince la lunghezza dei tubi presenti nei sub lotti 2.7.2, 2.7.5, 2.7.8.

La ditte **DEAS** e **TELEFLEX** offrono tutte le voci del sub lotto.

I dispositivi presentano, tuttavia, raccordo curvo non saldato ossia mobile e pertanto sono da ritenersi **NON IDONEI**.


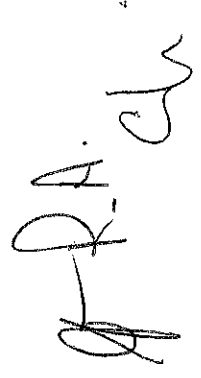
**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

LOTTO 3 CATETERE MOUNT

SUB LOTTO 3.1

**CATETERE MOUNT – RACCORDO COBB FISSO**

SUB LOTTO 3.1.1 lunghezza cm 5 circa

firmi  R.A. 

SUB LOTTO 3.1.2 lunghezza cm 10 circa

SUB LOTTO 3.1.3 lunghezza cm 15 circa

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, TELEFLEX.

La ditta **ALFAMED** offre tutte le voci del sublotto.

E' da ritenersi, tuttavia, **NON IDONEA** in quanto i dispositivi sono privi sia di raccordo di Cobb che di tappo di aspirazione.

Le ditte **COVIDIEN, DEAS, TELEFLEX** offrono tutte le voci del sub lotto ed i **dispositivi** sono **rispondenti** al richiesto.

Il punteggio assegnato è il seguente:

	COVIDIEN	DEAS	TELEFLEX
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima resistenza allo schiacciamento)	12	12	12
FLESSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima flessibilità)	6	6	6
DISTENSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della maggiore distensibilità)	6	6	6
TENUTA DELLE CONNESSIONI(facilità di connessione, assenza perdite nel momento della connessione, mancanza di resistenza alla deconnessione manuale)	12	12	12
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	17	17	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17	17	17
	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI

pru RA F R.A. CU

**SUB LOTTO 3.2**

**CATETERE MOUNT – RACCORDO COBB GIREVOLE**

SUB LOTTO 3.2.1 lunghezza cm 5 circa

SUB LOTTO 3.2.2 lunghezza cm 10 circa

SUB LOTTO 3.2.3 lunghezza cm 15 circa

Presentano offerta le ditte AIR LIQUID, COVIDIEN, DEAS, MEDISIZE, SANIC, TELEFLEX.

La ditta **AIR LIQUID** non offre la voce 3.2.1.

I dispositivi, essendo privi di raccordo di Cobb girevole, sono da ritenersi **NON IDONEI**.

In etichetta compare, inoltre, il simbolo degli ftalati senza che nella documentazione tecnica ci sia la dichiarazione di non rilascio.

La ditta **MEDISIZE** offre tutte le voci del sub lotto.

In etichetta compare il simbolo degli ftalati senza che nella documentazione tecnica ci sia la dichiarazione di non rilascio: è da ritenersi **NON IDONEA**.

LA ditte COVIDIEN, DEAS, SANIC, TELEFLEX offrono tutte le voci del sub lotto.

I dispositivi risultano rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

	COVIDIEN	DEAS	SANIC	TELEFLEX
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima resistenza allo schiacciamento)	12	12	12	12
FLESSIBILITA'(coefficiente maggiore in	6	6	6	6

*firmato R.A. el.*

corrispondenza della massima flessibilità)						
DISTENSIBILITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della maggiore distensibilità)	6	6	6	6	6	6
TENUTA DELLE CONNESSIONI(facilità di connessione, assenza perdite nel momento della connessione, mancanza di resistenza alla deconnessione manuale)	12	12	12	12	12	12
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	17	17	17	17	17	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17	17	17	17	17	17
TOTALE	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI	70 PUNTI

#### LOTTO 4 – MASCHERE ORO/NASALI

SUB LOTTO 4.1.1 MISURA 3

SUB LOTTO 4.1.2 MISURA 4

SUB LOTTO 4.1.3 MISURA 5

SUB LOTTO 4.1.4 MISURA 6

Presentano offerta le seguenti ditte: AIR LIQUID, ALFAMED, AMBU, BENEFIS, CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, DRAGER, FIMAS, HAROL, MEDISIZE, MEDIVAL, SANIC, SMITH'S MEDICAL, TELEFLEX.

QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su	ATRAUMATICITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	TOTALE
---	--	---	--	--------

*fu* *RA. CL*

	valutazione della commissione tecnica)				
BENEFIS	18	18	17	17	70 punti
CONVATEC	18	18	17	17	70 punti
DEAS	18	18	11,9	17	64,9 punti
DRAGER	18	18	17	17	70 punti
FIMAS	18	18	11,9	17	64,9 punti
HAROL	18	18	17	17	70 punti
MEDISIZE	18	18	17	17	70 punti
MEDIVAL	18	18	4,25	17	57,25 punti
SANIC	18	18	11,9	17	64,9 punti

Le ditte AIR LIQUID, AMBU, COVIDIEN, DIEMME, SMITH'S MEDICAL, TELEFLEX vengono escluse dalla valutazione per la mancanza di dichiarazione di assenza di rilascio di ftalati.

La ditta ALFAMED viene esclusa dalla valutazione in quanto presenta campioni con il cuscinetto di gonfiaggio lacerato.

Risulta, pertanto, NON IDONEA.

La ditta MEDIVAL risulta insufficiente nel parametro 'ERGONOMICITA' e MANEGGEVOLEZZA in quanto presenta dispositivo con valvola di gonfiaggio ingombrante che sporge dal perimetro della maschera e ne intralcia l'impugnatura.

Le ditte DEAS, FIMAS e SANIC raggiungono la sufficienza nello stesso parametro in quanto risultano poco sagomate sul profilo naso bocca risultando poco maneggevoli nell'impugnatura.

*fine* *AA* *de R.A.* *el.*

**SUB LOTTO 4.2**

**MASCHERA FACCIALE NEONATALE/PEDIATRICA**

SUB LOTTO 4.2.1 misura 0

SUB LOTTO 4.2.2 misura 1

SUB LOTTO 4.2.3 misura 2

Presentano offerta le ditte AIR LIQUID, ALFAMED, AMBU, BENEFIS, CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, DRAGER, HAROL, MEDISIZE, MEDIVAL, SMITH'S MEDICAL.

Solamente le ditte COVIDIEN e SMITH'S MEDICAL offrono dispositivi con cuscinetto non gonfiabile. Vengono, tuttavia, ritenute **NON IDONEE** in quanto i dispositivi campionati della ditta SMITH'S MEDICAL risultano privi di codice colore mentre la ditta COVIDIEN unicamente per la misura 2 offre dispositivi con codice colore e pertanto non rientra nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

Inoltre per i dispositivi offerti dalle ditte COVIDIEN e SMITH'S MEDICAL manca dichiarazione di assenza di rilascio di ftalati.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 4.3**

**MASCHERA FACCIALE TOTALE RISTERILIZZABILE**

SUB LOTTO 4.3.1 MASCHERA FACCIALE TOTALE RISTERILIZZABILE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA MIS. S

SUB LOTTO 4.3.2 MASCHERA FACCIALE TOTALE RISTERILIZZABILE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA MIS. M





SUB LOTTO 4.3.3 MASCHERA FACCIALE TOTALE RISTERILIZZABILEPERVENTILAZIONE NON INVASIVA MIS. L

SUB LOTTO 4.3.4 MASCHERA FACCIALE TOTALE RISTERILIZZABILEPERVENTILAZIONE NON INVASIVA MIS. XL

Presentano offerta le ditte DIMAR, HAROL, MEDISIZE.

La ditta MEDISIZE offre dispositivi non rispondenti al richiesto in quanto non trattasi di maschera facciale totale.

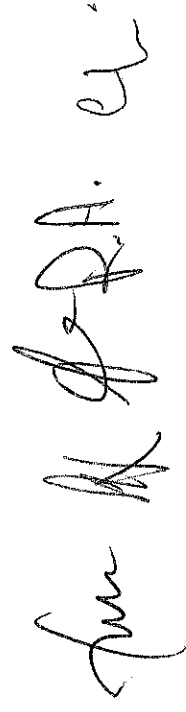
Il dispositivo presenta punti di appoggio sul naso e non copre gli occhi del paziente: viene ritenuta NON IDONEA.

Le ditte DIMAR ed HAROL offrono tutte e quattro le voci del sublotto tuttavia la ditta HAROL viene ritenuta NON IDONEA per la misura M, rientra comunque nell'idoneità dell'80% delle voci del sublotto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

	DIMAR	HAROL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della commissione tecnica)	12,6	18
ATRAUMATICITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18	18
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	12,75	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17	15,3
TOTALE	60,35	68,3

Il dispositivo campionato dalla ditta DIMAR raggiunge un punteggio inferiore nel parametro QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA in quanto il raccordo di sicurezza non essendo inserito richiede manovre di assemblaggio che potrebbero comportare una potenziale rottura del dispositivo e nel parametro QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA per la membrana di tenuta in silicone meno rigida e pertanto di tenuta minore.



La stessa ditta raggiunge un punteggio superiore nel parametro QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE in quanto il dispositivo campionato presenta un accesso dedicato che permette il passaggio di sondini e cateteri.

#### SUB LOTTO 4.4

#### MASCHERA FACIALE TOTALE RISTERILIZZABILE PER VENTILAZIONE CPAP

SUB LOTTO 4.4.1 mis. S

SUB LOTTO 4.4.2 mis. M

SUB LOTTO 4.4.3 mis. L

SUB LOTTO 4.4.4 mis. XL

Presentano offerta le ditte DIMAR e HAROL.

Le ditte offrono tutte e quattro le voci del sub lotto tuttavia la ditta HAROL viene ritenuta NON IDONEA per la misura M, rientra comunque nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

	DIMAR	HAROL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della commissione tecnica)	12,6	18
ATRAUMATICITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18	18
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	12,75	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17	15,3
TOTALE	60,35	68,3

Il dispositivo campionato dalla ditta DIMAR raggiunge un punteggio inferiore nel parametro QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA in quanto il raccordo di sicurezza non essendo inserito richiede manovre di assemblaggio che potrebbero comportare una potenziale rottura del dispositivo e nel parametro QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA per la membrana di tenuta in silicone meno rigida e pertanto di tenuta minore.

La stessa ditta raggiunge un punteggio superiore nel parametro QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE in quanto il dispositivo campionato presenta un accesso dedicato che permette il passaggio di sondini e cateteri.

#### **SUB LOTTO 4.5**

#### **MASCHERA FACIALE TOTALE MONOUSO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA**

SUB LOTTO 4.5.1 mis. S

SUB LOTTO 4.5.2 mis. M

SUB LOTTO 4.5.3 mis. L

SUB LOTTO 4.5.4 mis. XL

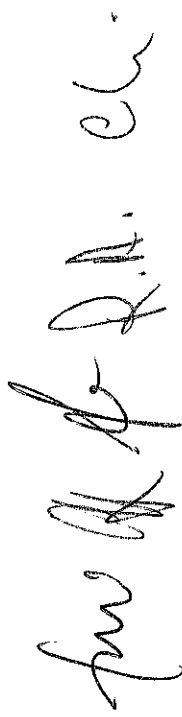
Presentano offerta le ditte AMBU, CORMED CARDIOVASCOLARE, DIMAR, HAROL

la ditta AMBU offre le prime tre voci del sub lotto tuttavia è da ritenersi NON IDONEA in quanto il dispositivo non è rispondente al richiesto perché non copre gli occhi del paziente.

La ditta CORMED CARDIOVASCOLARE offre tutte le voci del sub lotto .

Le prime tre voci sono da ritenersi NON IDONEE in quanto non presentano valvola di sicurezza né fori di aspirazione; le misure presentate, inoltre, non sono chiaramente riconducibili a quelle richieste : la ditta non rientra, pertanto, nell'80% di idoneità delle voci del sublotto.

La ditta DIMAR offre tutte e quattro le voci del sub lotto.



I dispositivi sono rispondenti al richiesto.

La ditta HAROL offre lo stesso dispositivo per 4.5.2 e 4.5.3.

I dispositivi sono tuttavia IDONEI e la ditta rientra nell'80% dell'idoneità delle voci del sub lotto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

	DIMAR	HAROL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della commissione tecnica)	12,6	18
ATRAUMATICITA'(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18	18
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	12,75	17
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE	17	15,3
TOTALE	60,35	68,3

Il dispositivo campionato dalla ditta DIMAR raggiunge un punteggio inferiore nel parametro QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA in quanto il raccordo di sicurezza non essendo inserito richiede manovre di assemblaggio che potrebbero comportare una potenziale rottura del dispositivo e nel parametro QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA per la membrana di tenuta in silicone risulta meno rigida e pertanto di tenuta minore.

La stessa ditta raggiunge un punteggio superiore nel parametro QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE in quanto il dispositivo campionato presenta un accesso dedicato che permette il passaggio di sondini e cateteri.

SUB LOTTO 4.6

MASCHERA FACCIALE TOTALE MONOUSO PER VENTILAZIONE CPAP

SUB LOTTO 4.6.1 misura S

SUB LOTTO 4.6.2 misura M

20

*fu R.A. cl.*

SUB LOTTO 4.6.3 misura L

SUB LOTTO 4.6.4 misura XL

Presentano offerta le ditte AMBU, DIMAR, HAROL, MEDIVAL, SC FORNITURE OSPEDALIERE.

La ditta AMBU, analogamente alla ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE offre dispositivi NON IDONEI in quanto non coprono completamente gli occhi del paziente.

La ditta HAROL offre dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di fori di aspirazione.

La ditta MEDIVAL offre lo stesso dispositivo per i sub lotti 4.6.1 e 4.6.2 e per 4.6.3 e 4.6.4

Pertanto non rientrando nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto è da ritenersi NON IDONEA.

La ditta DIMAR offre dispositivi rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

	DIMAR
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
TOTALE	70 PUNTI

SUB LOTTO 4.7

MASCHERA ORO NASALE RISTERILIZZABILE CON VALVOLA ESPIRATORIA

SUB LOTTO 4.7.1 misura 3

SUB LOTTO 4.7.2 misura 4

*fu* *di* *di* *P.A.* *en*

**SUB LOTTO 4.7.3** misura 5

**SUB LOTTO 4.7.4** misura 6

Presenta offerta la ditta DIMAR che offre tutte e 4 le voci del sub lotto.

I dispositivi sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

	DIMAR
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
<b>TOTALE</b>	<b>70 PUNTI</b>

**SUB LOTTO 4.8**

**MASCHERA ORO NASALE RISTERILIZZABILE SENZA VALVOLA ESPIRATORIA**

SUB LOTTO4.8.1 misura 3

SUB LOTTO4.8.2 misura 4

SUB LOTTO4.8.3 misura 5

SUB LOTTO4.8.4 misura 6

Presentano offerta le ditte DIMAR, MEDISIZE, S.C.FORNITURE OSPEDALIERE.

*fu R. A. D.A. et.*

La ditta DIMAR offre tutte le voci del sub lotto ed il dispositivo è rispondente al richiesto.

La ditta MEDISIZE offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto dotato di valvola espiratoria.

La ditta DIMAR non offre la misura 6, i dispositivi sono rispondenti al richiesto e rientrano comunque nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

	DIMAR	SC FORNITURE OSPEDALIERE
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	16,2
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	15,3	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17	17
TOTALE	68,3 punti	68,2 punti
TOTALE NORMALIZZATO	70 PUNTI	69,8 PUNTI

La ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE raggiunge un punteggio più alto nel parametro ergonomia e maneggevolezza in quanto offre un dispositivo in cui risulta più facile la regolazione del cuscinetto del sostegno frontale.

La ditta DIMAR raggiunge un punteggio superiore nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura per la presenza di una membrana di appoggio facciale dotata di maggiore rigidità.

### LOTTO 5 SCAFANDRI

#### SUB LOTTO 5.1

#### SCAFANDRO PER CPAP

per R.F. R.A. G.I.

SUB LOTTO 5.1.1 misura ADULTI SMALL

SUB LOTTO 5.1.2 misura ADULTI MEDIUM

SUB LOTTO 5.1.3 misura ADULTI LARGE

SUB LOTTO 5.1.4 misura ADULTI XL

SUB LOTTO 5.1.5 misura PEDIATRICA 5/15KG

SUB LOTTO 5.1.6 misura NEONATALE 3/5KG

Presentano offerta le ditte CORMED CARDIOVASCOLARE, COVIDIEN, HAROL.

La ditta CORMED CARDIOVASCOLARE viene ritenuta NON IDONEA in quanto il generatore offerto non permette il monitoraggio dei parametri così come richiesto da capitolato.

La ditta COVIDIEN risponde a tutte le voci del sub lotto.

Non presentando alcuna documentazione tecnica inerente il generatore di flusso viene ritenuta NON IDONEA.

Si rileva inoltre, a parere della Commissione, mancata corrispondenza tra quanto riportato su schede tecniche e quanto richiesto nel capitolato inerentemente le misure pediatrica e neonatale: non viene ritenuto idoneo per 3/5 kg il diametro 50mm né il diametro 60mm per un peso 5/15kg.

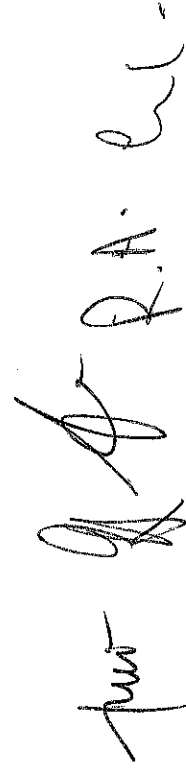
La ditta HAROL offre le prime 5 voci del sub lotto.

Risulta non idonea per la voce 5.1.5 in quanto dalla documentazione tecnica si evince l'utilizzo in pazienti da 5 a 10 anni mentre nel capitolato è richiesto l'utilizzo in pazienti da 5 a 15 kg.

Rientra comunque nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

I dispositivi sono rispondenti a quanto richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

24

per  R.A. C.L.



	HAROL
qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	17
Accessori aggiuntivi migliorativi dell'offerta	7
Atraumaticità ((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	12
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
<b>TOTALE</b>	<b>70 punti</b>

**SUB LOTTO 5.2**

**SCAFANDRO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA**

SUB LOTTO 5.2.1 misura ADULTI SMALL

SUB LOTTO 5.2.2 misura ADULTI MEDIUM

SUB LOTTO 5.2.3 misura ADULTI LARGE

SUB LOTTO 5.2.4 misura ADULTI XL

SUB LOTTO 5.2.5 misura PEDIATRICA 5/15KG

SUB LOTTO 5.2.6 misura NEONATALE 3/5KG

Presentano offerta le ditte CORMED CARDIOVASCOLARE, COVIDIEN, HAROL.

*per H.A. el.*

La ditta **CORMED CARDIOVASCOLARE** risponde alle prime 5 voci del sub lotto e viene ritenuta **NON IDONEA** in quanto manca dichiarazione assenza rilascio ftalati.

Risulta **NON IDONEA** per 5.2.5 in quanto offre un dispositivo idoneo per pazienti oltre 15Kg.

La ditta **COVIDIEN** offre tutte le voci del sub lotto.

Risulta non rispondente per 5.5.5 e 5.2.6 in quanto non è possibile ricondurre le misure richieste con i valori riportati su scheda tecnica.

Rientra comunque nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.


La ditta **HAROL** risponde alle prime 5 voci del sub lotto.

Risulta non idonea per la voce 5.1.5 in quanto dalla documentazione tecnica si evince l'utilizzo in pazienti da 5 a 10 anni mentre nel capitolato è richiesto l'utilizzo in pazienti da 5 a 15 kg.

Risultando idonea per le rimanenti voci rientra tuttavia nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

	COVIDIEN	HAROL
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	15,3	12,75
Accessori aggiuntivi migliorativi dell'offerta	7	7
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	12	9
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17	11,9
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17	14,45

qui  R.A. C.A.

TOTALE	68,3PUNTI	55,1 PUNTI
--------	-----------	------------

La differenza di punteggio nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura è da attribuirsi alla consistenza del casco.

La ditta HAROL raggiunge un punteggio inferiore nel parametro Atraumaticità per la presenza di alette alla base del casco nonché di anello più rigido che potrebbero essere poco tollerabili dal paziente.

La ditta COVIDIEN raggiunge un punteggio superiore nel parametro Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza perché offre un dispositivo più leggero e quindi più maneggevole.

Alla ditta COVIDIEN viene attribuito un punteggio superiore nel parametro Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente in quanto il dispositivo presenta apertura che permette un accesso al paziente più rapido ed agevole.

### SUB LOTTO 5.3

#### CASCO DA CPAP DA UTILIZZARE IN EMERGENZA

Presentano offerta le ditte COVIDIEN e HAROL.

Il dispositivo offerto dalla ditta HAROL viene ritenuto NON IDONEO in quanto non di taglia unica. Non è possibile infatti regolare la misura in base alle esigenze.

I dispositivi offerti dalla ditta COVIDIEN sono RISPONDENTI a quanto richiesto ed alle esigenze degli utilizzatori.

Il punteggio assegnato è il seguente:

	COVIDIEN
qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	17
Accessori aggiuntivi migliorativi dell'offerta	7
Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della	12

*per: [Signature] R.A. C.A.*

Commissione tecnica)	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
<b>TOTALE</b>	<b>70 PUNTI</b>

**SUB LOTTO 5.4**

**MASCHERA CPAP PER EMERGENZA**

SUB LOTTO 5.4.1 small/medium

SUB LOTTO 5.4.2 large/XL

Presentano offerta le ditte CORMED CARDIOVASCOLARE, DIMAR, HAROL.

La ditta CORMED CARDIOVASCOLARE risponde a tutte le voci del sub lotto ma viene ritenuta **NON IDONEA** per mancanza di dichiarazione di non rilascio di ftalati.

La ditta HAROL viene ritenuta **NON IDONEA** in quanto offre due misure non rispondenti: nel capitolato vengono indicate misure S/M e misura L/XL mentre la ditta offre una misura per ADULTI ed una misura M ADULTI che non possono essere ricondotte a quanto richiesto.

I dispositivi offerti dalla ditta DIMAR SONO RISPONDENTI AL RICHIESTO ed il punteggio assegnato è il seguente:

	DIMAR
qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	17
Accessori aggiuntivi migliorativi dell'offerta	7

*per A.F. R.A. CA.*

Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	12
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
TOTALE	70 PUNTI

**LOTTO 6 MASCHERE LARINGEE**

**SUB LOTTO 6.1**

**MASCHERA LARINGEA MONOUSO**

SUB LOTTO 6.1.1 maschera laringea monouso mis.1

SUB LOTTO 6.1.2 maschera laringea monouso mis.1,5

SUB LOTTO 6.1.3 maschera laringea monouso mis.2

SUB LOTTO 6.1.4 maschera laringea monouso mis.2,5


SUB LOTTO 6.1.5 maschera laringea monouso mis.3

SUB LOTTO 6.1.6 maschera laringea monouso mis.4

SUB LOTTO 6.1.7 maschera laringea monouso mis.5

Presentano offerta le seguenti ditte: AIR LIQUID, ALFAMED, AMBU, CONVATEC, DEAS, DIEMME, FIMAS, HAROL, MEDIVAL, SANIC, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

Le offerte delle ditte TELEFLEX, DIEMME, AIR LIQUID vengono ritenute NON IDONEE per mancata dichiarazione di assenza di rilascio di ftalati.

*fu*  *R.A. Cl.*

La ditta SMITHS MEDICAL non offre le misure 1 e 1,5, rientra comunque nell' idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

I dispositivi offerti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità((coefficiente in maggiore corrispondenza massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	18	18	17	15,3	68,3 PUNTI
AMBU	13,5	18	17	11,9	60,4 PUNTI
CONVATEC	12,6	12,6	17	17	59,2 PUNTI
DEAS	13,5	18	17	15,3	63,8 PUNTI
FIMAS	12,6	18	17	15,3	62,9 PUNTI
HAROL	12,6	18	17	17	64,6 PUNTI
MEDIVAL	18	18	17	15,3	68,3 PUNTI
SANIC	12,6	18	17	17	64,6 PUNTI
SMITHS MEDICAL	18	18	17	15,3	68,3 PUNTI

Le ditte ALFAMED, MEDIVAL e SMITH raggiungono un punteggio superiore nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura per la presenza nel dispositivo di tubo in silicone, le altre differenze sono da attribuirsi alla rigidità del tubo.

La ditta CONVATEC raggiunge un punteggio inferiore nel parametro atraumaticità per la presenza di un raccordo tubo-maschera più rigido rispetto a quello delle altre ditte.

Le differenze di punteggio ottenute nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente sono da attribuirsi alla differente trasparenza del tubo della maschera.

**SUB LOTTO 6.2**

*fu. H de R.A. Cl.*

**MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI**

SUB LOTTO 6.2.1 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI mis.3

SUB LOTTO 6.2.2 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI mis.4

SUB LOTTO 6.2.3 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI mis.5

Presentano offerta le ditte: AMBU, FIMAS, TELEFLEX

Le ditte AMBU e FIMAS vengono ritenute NON IDONEE in quanto presentano dispositivi non flessibili e pertanto tali da non permettere il posizionamento direzionale con una sola mano.

La ditta TELEFLEX viene ritenuta NON IDONEA in quanto i dispositivi offerti contengono ftalati e non si evince dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 6.3**

**MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA**

SUB LOTTO 6.3.1 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 2

SUB LOTTO 6.3.2 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 2,5

SUB LOTTO 6.3.3 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 3

SUB LOTTO 6.3.4 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 4

SUB LOTTO 6.3.5 MASCHERA LARINGEA MONOUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 5

Hanno presentato offerta le ditte AMBU, DEAS, FIMAS, TELEFLEX.

*pm* *A. P. R. A. el.*

I dispositivi offerti dalle ditte AMBU e TELEFLEX vengono ritenuti NON IDONEI per la presenza di ftalati e la mancata dichiarazione di non rilascio.

I dispositivi campionati dalle ditte DEAS e FIMAS sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

	DEAS	FIMAS
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	12,6	13,5
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	12,6	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17	17
<b>TOTALE</b>	<b>59,2 PUNTI</b>	<b>65,5 PUNTI</b>

Il dispositivo offerto dalla ditta FIMAS viene considerato di qualità buona nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura a causa del mantenimento di memoria da parte del tubo dopo lo schiacciamento.

Il dispositivo offerto dalla ditta DEAS viene considerato di qualità sufficiente nello stesso parametro in quanto in uno dei due campioni presentati una volta gonfiata la cuffia si apprezzano irregolarità di gonfiaggio che determinano zone di consistenza maggiore per mancata espansione gassosa che possono determinare lesioni della mucosa.

Analogamente le irregolarità di gonfiaggio della cuffia del dispositivo della ditta DEAS causano una maggiore traumaticità che fa in modo che la ditta stessa raggiunga la sufficienza nel parametro 'ATRAUMATICITA'.

#### **SUB LOTTO 6.4**

#### **MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO**

SUB LOTTO 6.4.1 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura 1



- SUB LOTTO 6.4.2 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura 1,5
- SUB LOTTO 6.4.3 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura ,2
- SUB LOTTO 6.4.4 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura 2,5
- SUB LOTTO 6.4.5 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura ,3
- SUB LOTTO 6.4.6 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura 4
- SUB LOTTO 6.4.7 MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO misura 5

Presentano offerta le ditte FIMAS e TELEFLEX.

La ditta FIMAS viene ritenuta **NON IDONEA** in quanto presenta un dispositivo privo di valvola di gonfiaggio cuffia.

I dispositivi offerti dalla ditta TELEFLEX sono **RITENUTI** non idonei in quanto contengono ftalati e manca la dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**


#### **SUB LOTTO 6.5**

#### **MASCHERA LARINGEA PLURIUSO**

Sub lotto 6.5.1 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.1

Sub lotto 6.5.2 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.1,5

Sub lotto 6.5.3 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.2

*fuori*  *R.A. Ca.*

Sub lotto 6.5.4 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.2,5

Sub lotto 6.5.5 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.3

Sub lotto 6.5.6 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.4

Sub lotto 6.5.7 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO mis.5

Presentano offerta le seguenti ditte: AIR LIQUID, AMBU, DEAS, DIEMME, TELEFLEX.

La ditta AMBU campiona un dispositivo NON RISPONDENTE per l'assenza di trasparenza così come richiesto.

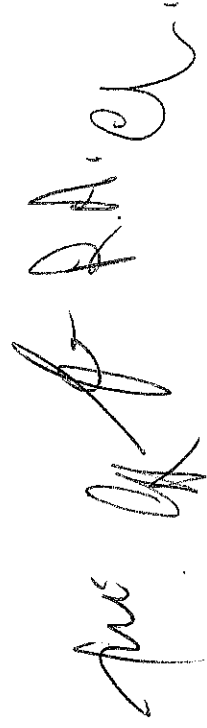
La cuffia, inoltre, può scuffiarsi accidentalmente con l'apertura del tappino della valvola di gonfiaggio.

Le rimanenti ditte campionano dispositivi rispondenti nonché tutte le misure richieste ed il punteggio assegnato è il seguente:

	AIR LIQUID	DEAS	DIEMME	TELEFLEX
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	18	18	18
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	16,2	18	18	16,2
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	12,75	17	17	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	11,9	17	17	17
TOTALE	58,85	70	70	68,2

Le differenze di punteggio attribuite al parametro atraumaticità sono da imputarsi alla rigidità della cuffia mentre per la maneggevolezza sono da imputarsi alla flessibilità del tubo e per la sicurezza per il paziente all'assenza di trasparenza del tubo ossia all'opacità.

**SUB LOTTO 6.6**



**MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI**

SUB LOTTO 6.6.1 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI misura 3

SUB LOTTO 6.6.2 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI misura 4

SUB LOTTO 6.6.3 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER L'EMERGENZA E LE VIE AEREE DIFFICILI misura 5

Presenta offerta la ditta TELEFLEX.

La ditta offre tutte le misure richieste ed il dispositivo risulta RISPONDENTE.

Il punteggio assegnato è il seguente:

	TELEFLEX
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
TOTALE	70 PUNTI

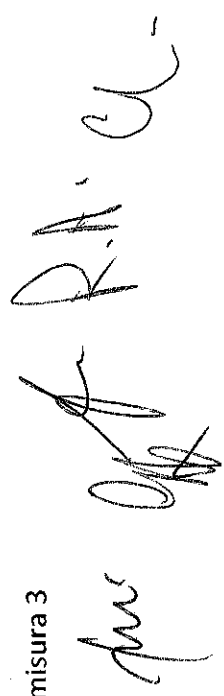
**SUB LOTTO 6.7**

**MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA**

SUB LOTTO 6.7.1 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 2

SUB LOTTO 6.7.2 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 2,5

SUB LOTTO 6.7.3 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 3

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'R.A.' followed by a stylized signature.

SUB LOTTO 6.7.4 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 4

SUB LOTTO 6.7.5 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO PER LA CHIRURGIA DEL COLLO E DELLA TESTA misura 5

Presenta offerta la ditta TELEFLEX.

La ditta offre tutte le misure richieste ed il dispositivo risulta RISPONDENTE.

Il punteggio assegnato è il seguente:

	TELEFLEX
qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18
Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
TOTALE	70 PUNTI

**SUB LOTTO 6.8**

**MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO**

SUB LOTTO M6.8.1 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO misura 1,5

SUB LOTTO M6.8.2 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO misura 2

SUB LOTTO M6.8.3 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO misura 2,5

SUB LOTTO M6.8.4 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO misura 3

SUB LOTTO M6.8.5 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO misura 4

SUB LOTTO M6.8.6 MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO misura 5

*per offerta R.A. Et.*

Presenta offerta la ditta TELEFLEX.

La ditta offre tutte le misure richieste ed il dispositivo risulta RISPONDENTE.

Il punteggio assegnato è il seguente:

	TELEFLEX
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18
Atraumaticità((coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17
TOTALE	70 PUNTI

#### LOTTO 7 -RACCORDI VARI

**SUB LOTTO 7.1 – RACCORDO ANGOLATO O AD “L”** misura unica da interporre tra circuito respiratorio e maschera facciale

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL, TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta COVIDIEN risulta NON IDONEO in quanto non si raccorda al circuito respiratorio ma solamente alla maschera facciale.

I dispositivi offerti dalle rimanenti ditte risultano IDONEI ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
-------	--	--	---	--------

*fu R.A. cl*

	resistenza su valutazione della Commissione tecnica)			
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
TELEFLEX	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.2 – RACCORDO A T DRITTO 22M-22M-22M/15F CON PRESA TEMPERATURA FEMMINA**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL.

I dispositivi offerti dalle ditte risultano IDONEI ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

*for A of D.A. eh*

**SUB LOTTO 7.3 -- RACCORDO A T DRITTO 22M-22M-22M/15F SENZA PRESA TEMPERATURA**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL, TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta FIMAS viene considerato NON IDONEO in quanto non è presente il raccordo 22M/15F bensì solo il raccordo 22M.

I rimanenti dispositivi sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

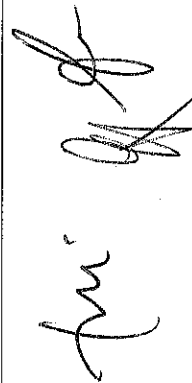
ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
TELEFLEX	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.4 -- RACCORDO A Y PER ADULTI PER CIRCUITI**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL, TELEFLEX.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

*fu*  *R.A. Al.*

COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
TELEFLEX	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.5 – RACCORDO DRITTO 22M-22M/15F**


Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL, TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta COVIDIEN viene considerato NON IDONEO in quanto viene presentato raccordo 22M-15F anziché 22M-22M/15F come richiesto.

I dispositivi offerti dalle rimanenti ditte sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
TELEFLEX	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.6 – RACCORDO DI COBB 15M PER TUBO ENDOTRACHEALE FISSO**

*fu*  *A.A. Ch.*



Presentano offerta le ditte COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.7 – RACCORDO DI COBB 15M PER TUBO ENDOTRACHEALE GIREVOLE**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL, TELEFLEX.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
TELEFLEX	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

*fm. [Signature] R.A. Cl.*

**SUB LOTTO 7.8 – RACCORDO DRITTO 22M/15F-22M/15F**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL.

I dispositivi offerti dalle ditte COVIDIEN , FIMAS e MEDIVAL sono da ritenersi NON IDONEI in quanto presentano il raccordo 22M/15F solamente da un lato.

I dispositivi offerti dalla ditta DEAS sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

	DEAS
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	23
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	22
TOTALE	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.9 – TAPPO 22F**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE

*Handwritten signature and initials*

ALFAMED	25 PUNTI	16,1 PUNTI	22 PUNTI	63,1 PUNTI
COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	17,25 PUNTI	22 PUNTI	64,25 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	17,25 PUNTI	22 PUNTI	64,25 PUNTI

Le differenze raggiunte nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza sono da imputarsi per la ditta ALFAMED alla difficoltà a raccordarsi, per la ditta FIMAS alla presenza di alette che rendono meno agevole la connessione, per la ditta MEDIVAL alla presenza di filettatura interna che rende meno agevole la connessione su un supporto liscio.

#### SUB LOTTO 7.10 – RACCORDO A T 22F-22M-22M

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL.

Il dispositivo offerto dalla ditta FIMAS risulta NON IDONEO in quanto presenta raccordo 15F anziché 22F come richiesto.

I dispositivi offerti dalle rimanenti ditte sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

*qui a P.A. el*

**SUB LOTTO 7.11 – RACCORDO A T PER CPAP IN TRACHEO 22F-22M/15F-22M/15F**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, MEDIVAL.

Il dispositivo offerto dalla ditta COVIDIEN risulta NON IDONEO in quanto privo di un raccordo 15F.

I dispositivi offerti dalle rimanenti ditte sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.12 – RACCORDO RETTO PER NIV. 22F/22F**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALFAMED	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

*fu' off. D.A. CL.*

COVIDIEN	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
FIMAS	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI
MEDIVAL	25 PUNTI	23 PUNTI	22 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 7.13 – RACCORDI BICONICI SIMMETRICI**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, MEDIVAL, TAU MEDICA.

Il dispositivo offerto dalla ditta MEDIVAL risulta NON IDONEO in quanto triconico e non biconico.

Analogamente il dispositivo offerto dalla ditta COVIDIEN risulta NON IDONEO per l'impossibilità di individuare sia da scheda tecnica che da campionatura le misure richieste.

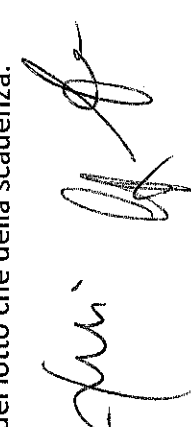
Il dispositivo offerto dalla ditta TAU MEDICA risulta rispondente al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

	TAU MEDICA
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	23
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	22
<b>TOTALE</b>	<b>70 PUNTI</b>

**SUB LOTTO 7.14 – RACCORDI AD Y**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, MEDIVAL, TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta COVIDIEN risulta NON IDONEO in quanto privo, in etichetta, sia del lotto che della scadenza.

*Qui*  *R.A. et.*

Il dispositivo offerto dalla ditta MEDIVAL risulta NON IDONEO in quanto risulta biconico anziché ad Y.

Il dispositivo offerto dalla ditta TELEFLEX risulta NON IDONEO in quanto difforme dal richiesto: trattasi, infatti, di raccordo per circuito respiratorio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 7.15 RACCORDO QUADRUPLO PER ANESTESIA PERIANALE**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 7.16 FILO IN SILICONE PER DRENAGGIO ASCESSO E FISTOLA ANALE**

Nessuna ditta presenta offerta.

**LOTTO 8 TUBI ENDOTRACHEALI ED ACCESSORI**

**SUB LOTTO 8.1**

**TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO**

SUB LOTTO 8.1.1 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 3

*fu A J R.A. chi*

SUB LOTTO 8.1.2 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 3,5  
SUB LOTTO 8.1.3 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 4  
SUB LOTTO 8.1.4 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 4,5  
SUB LOTTO 8.1.5 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 5  
SUB LOTTO 8.1.6 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 5,5  
SUB LOTTO 8.1.7 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 6  
SUB LOTTO 8.1.8 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 6,5  
SUB LOTTO 8.1.9 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 7  
SUB LOTTO 8.1.10 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 7,5  
SUB LOTTO 8.1.11 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 8  
SUB LOTTO 8.1.12 TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO mm 8,5

Presentano offerta le seguenti ditte: ALFAMED, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, SANIC, SECURMED, TELEFLEX.

I dispositivi offerti dalle ditte SECURMED e DIEMME risultano NON IDONEI in quanto privi di mandrino e dotati di curvatura preformata non sostenibile.

I dispositivi offerti dalle ditte ALFAMED, COVIDIEN, SANIC, TELEFLEX vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati e dalla documentazione tecnica non si evince assenza di rilascio.

La ditta DEAS offre tutte le misure richieste ed i dispositivi sono rispondenti a quanto riportato nel capitolato.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

*fu off. D.A. ch.*

diitta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	costruttiva	TOTALE
DEAS	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI		70 PUNTI

### SUB LOTTO 8.2

#### TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO

SUB LOTTO 8.2.1 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mm 3

SUB LOTTO 8.2.2 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mm 3,5

SUB LOTTO 8.2.3 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mm 4

SUB LOTTO 8.2.4 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mm 4,5

Presentano offerta le seguenti ditte: CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, SECURMED, TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta CONVATEC risulta NON IDONEO in quanto privo di tacche di riferimento pe le corde vocali.

Le ditte COVIDIEN, DIEMME, SECURMED, TELEFLEX vengono ritenute NON IDONEE in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

La ditta DEAS offre tutte le misure ed i dispositivi sono rispondenti al richiesto, i punteggi assegnati sono i seguenti:

*dm' R. A. Ci*



ditto	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18 PUNTI	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18 PUNTI	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17 PUNTI	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17 PUNTI	TOTALE	70 PUNTI
DEAS		18 PUNTI		18 PUNTI		17 PUNTI		17 PUNTI		70 PUNTI

**SUB LOTTO 8.3**

**TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO PER ADULTI**

SUB LOTTO 8.3.1 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 5

SUB LOTTO 8.3.2 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 5,5

SUB LOTTO 8.3.3 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 6

SUB LOTTO 8.3.4 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 6,5

SUB LOTTO 8.3.5 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 7

SUB LOTTO 8.3.6 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 7,5

SUB LOTTO 8.3.7 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 8

SUB LOTTO 8.3.8 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 8,5

SUB LOTTO 8.3.9 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO ADULTI mm 9

Presentano offerta le seguenti ditte: CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, FIMAS, SANIC, SECURMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

*for R.A. elw*

Le ditte COVIDIEN, DIEMME, FIMAS, SECURMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX vengono ritenute NON IDONEE in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

Le rimanenti ditte offrono tutte le misure ed i dispositivi sono rispondenti al richiesto, i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CONVATEC	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI
SANIC	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 8.4**

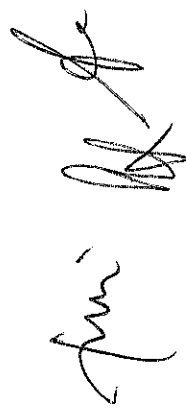
**TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO**

SUB LOTTO 8.4.1 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.2

SUB LOTTO 8.4.2 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.2,5

SUB LOTTO 8.4.3 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.3

SUB LOTTO 8.4.4 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.3,5

*fmi*  R.A. er.

- SUB LOTTO 8.4.5 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.4  
 SUB LOTTO 8.4.6 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.4,5  
 SUB LOTTO 8.4.7 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.5  
 SUB LOTTO 8.4.8 TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO NEONATALE E PEDIATRICO mis.5,5

Presentano offerta le ditte ALFAMED, CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, SANIC, SECURMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX presenta incongruenza tra etichetta del campione e documentazione tecnica: sulla documentazione tecnica viene evidenziata la presenza di ftalati mentre in etichetta non compare il simbolo.

Viene pertanto ritenuta NON IDONEA.

Analogamente le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DIEMME, SANIC, SECURMED, SMITHS MEDICAL vengono ritenute NON IDONEE in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

Le rimanenti ditte offrono tutte le voci del lotto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditte	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CONVATEC	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	14,45 PUNTI	67,45 PUNTI

*fu* *af* *P.A.* *cc*

La differenza di punteggio raggiunta nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente è da attribuirsi alla presenza solamente dell'occhio di Murphy o delle linee di marcatura per le corde vocali.

**SUB LOTTO 8.5**

**TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO**

SUB LOTTO 8.5.1 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.3

SUB LOTTO 8.5.2 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.3,5

SUB LOTTO 8.5.3 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.4

SUB LOTTO 8.5.4 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.4,5

SUB LOTTO 8.5.5 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.5

SUB LOTTO 8.5.6 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.5,5

SUB LOTTO 8.5.7 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.6

SUB LOTTO 8.5.8 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.6,5

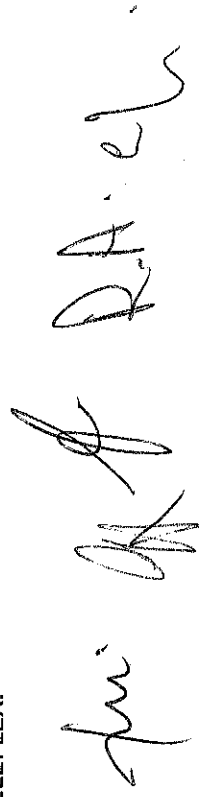
SUB LOTTO 8.5.9 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.7

SUB LOTTO 8.5.10 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.7,5

SUB LOTTO 8.5.11 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.8

SUB LOTTO 8.5.12 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO NON CUFFIATO mis.8,5

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, DEAS, DIEMME, SECURMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.



La ditta TELEFLEX offre un tubo cuffiato che non essendo rispondente al richiesto viene ritenuto NON IDONEO.

Le ditte COVIDIEN, DIEMME, SMITHS MEDICAL, SECURMED vengono ritenute NON IDONEE in quanto i dispositivi offerti contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

La ditta DEAS non offre la misura 3. I rimanenti dispositivi sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore corrispondenza massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
DEAS	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI

#### SUB LOTTO 8.6

#### TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO

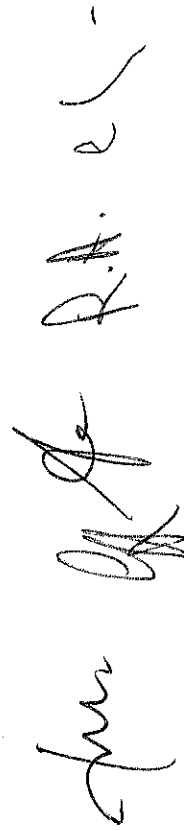
SUB LOTTO 8.6.1 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 4

SUB LOTTO 8.6.2 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 4,5

SUB LOTTO 8.6.3 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 5

SUB LOTTO 8.6.4 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 5,5

SUB LOTTO 8.6.5 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 6



- SUB LOTTO 8.6.6 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 6,5
- SUB LOTTO 8.6.7 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 7
- SUB LOTTO 8.6.8 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 7,5
- SUB LOTTO 8.6.9 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 8
- SUB LOTTO 8.6.10 TUBO ENDOTRACHEALE ORALE PREFORMATO ANGOLATO CUFFIATO misura 8,5

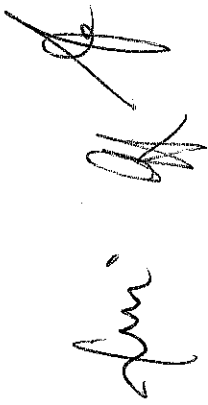
Presentano offerta le ditte ALFAMED, CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, SANIC, SECURMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX offre un dispositivo non rispondente al richiesto in quanto campiona un tubo nasale e non orale: viene infatti considerata NON IDONEA.

Le ditte ALFAMED, COVIDIEN, DIEMME, SANIC, SECURMED, SMITHS MEDICAL offrono dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio: vengono pertanto dichiarate NON IDONEE.

I dispositivi offerti dalle rimanenti ditte sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore corrispondenza massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza e per il paziente	TOTALE
CONVATEC	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI
DEAS	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI

*firmi*  *F.A. elu*

**SUB LOTTO 8.7**

**TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO**

- SUB LOTTO 8.7.1 TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO misura 6
- SUB LOTTO 8.7.2 TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO misura 6,5
- SUB LOTTO 8.7.3 TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO misura 7
- SUB LOTTO 8.7.4 TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO misura 7,5
- SUB LOTTO 8.7.5 TUBO ENDOTRACHEALE NASALE PREFORMATO misura 8

Presentano offerta le ditte AIR LIQUID, CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, SANIC, SECURMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

Solamente i dispositivi delle ditte COVIDIEN e SMITHS MEDICAL risultano essere morbidi e di facile inserimento ma contenendo ftalati, in assenza di dichiarazione di non rilascio, vengono considerati NON IDONEI.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 8.8**

**TUBO ENDOTRACHEALE PER CHIRURGIA LARINGEA**

- SUB LOTTO 8.8.1 TUBO ENDOTRACHEALE PER CHIRURGIA LARINGEA misura 4
- SUB LOTTO 8.8.2 TUBO ENDOTRACHEALE PER CHIRURGIA LARINGEA misura 4,5
- SUB LOTTO 8.8.3 TUBO ENDOTRACHEALE PER CHIRURGIA LARINGEA misura 5

55

*firmi P. A. el.*

SUB LOTTO 8.8.4 TUBO ENDOTRACHEALE PER CHIRURGIA LARINGEA misura 5,5

SUB LOTTO 8.8.5 TUBO ENDOTRACHEALE PER CHIRURGIA LARINGEA misura 6

Presentano offerta le ditte COVIDIEN e TELEFLEX.

La ditta COVIDIEN offre solamente le misure 4, 5, 6: non rientra nell'80% delle voci del sub lotto e pertanto viene esclusa dalla valutazione, contiene inoltre ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

Analogamente i dispositivi della ditta TELEFLEX contenendo ftalati senza che vi sia la dichiarazione di non rilascio vengono ritenuti NON IDONEI.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 8.9**

**TUBO ENDOTRACHEALE PER LASERTERAPIA(CHIRURGIA LASER)**

SUB LOTTO 8.9.1 TUBO ENDOTRACHEALE PER LASERTERAPIA(CHIRURGIA LASER) misura 4,5

SUB LOTTO 8.9.2 TUBO ENDOTRACHEALE PER LASERTERAPIA(CHIRURGIA LASER) misura 5

SUB LOTTO 8.9.3 TUBO ENDOTRACHEALE PER LASERTERAPIA(CHIRURGIA LASER) misura 5,5

SUB LOTTO 8.9.4 TUBO ENDOTRACHEALE PER LASERTERAPIA(CHIRURGIA LASER) misura 6

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

I dispositivi offerti contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio e pertanto vengono considerati NON IDONEI.

*Im' d' R.A. c.s.*



PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.

**SUB LOTTO 8.10**

**TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE**

SUB LOTTO 8.10.1 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 5

SUB LOTTO 8.10.2 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 5,5

SUB LOTTO 8.10.3 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 6

SUB LOTTO 8.10.4 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 6,5

SUB LOTTO 8.10.5 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 7

SUB LOTTO 8.10.6 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 7,5

SUB LOTTO 8.10.7 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 8

*fu' DK de P.A. CL*

SUB LOTTO 8.10.8 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 8,5

SUB LOTTO 8.10.9 TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE misura 9

SUB LOTTO 8.10.10 LINEA DI ASPIRAZIONE LUNGHEZZA CM150 CIRCA

SUB LOTTO 8.10.11 FILTRO IDROFOBICO PER SISTEMA DI ASPIRAZIONE

SUB LOTTO 8.10.12 RESERVOIR MONOUSO PER SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

I dispositivi offerti contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio e pertanto vengono considerati NON IDONEI.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

## **LOTTO 9 DISPOSITIVI BRONCHIALI**

**SUB LOTTO 9.1**

### **TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA**

SUB LOTTO 9.1.1 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 28

SUB LOTTO 9.1.2 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 28

*Firma di P. A. J. et al.*

SUB LOTTO 9.1.3 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 30  
SUB LOTTO 9.1.4 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 30  
SUB LOTTO 9.1.5 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 32  
SUB LOTTO 9.1.6 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 32  
SUB LOTTO 9.1.7 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 34  
SUB LOTTO 9.1.8 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 34  
SUB LOTTO 9.1.9 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 37  
SUB LOTTO 9.1.10 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 37  
SUB LOTTO 9.1.11 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 39  
SUB LOTTO 9.1.12 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 39  
SUB LOTTO 9.1.13 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO DX mis 41  
SUB LOTTO 9.1.14 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA POLIURETANO SN mis 41  
SUB LOTTO 9.1.15 SISTEMA CPAP COMPLETO PER TUBO ENDOTRACHEALE per intubazione bronchiale selettiva

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

Non risponde ai progressivi 1, 3,4,5: non rientra, pertanto, nell'80% delle voci del sub lotto.

La ditta inoltre offre dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

Viene considerata NON IDONEA.

*Qui de P.A. cl.*  
*OK*

PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.

**SUB LOTTO 9.2**

**TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA**

SUB LOTTO 9.2.1 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.28

SUB LOTTO 9.2.2 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.28

SUB LOTTO 9.2.3 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.30

SUB LOTTO 9.2.4 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.30

SUB LOTTO 9.2.5 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.32

SUB LOTTO 9.2.6 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.32

SUB LOTTO 9.2.7 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.34

SUB LOTTO 9.2.8 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.34

SUB LOTTO 9.2.9 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.37

SUB LOTTO 9.2.10 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.37

SUB LOTTO 9.2.11 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.39

SUB LOTTO 9.2.12 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.39

SUB LOTTO 9.2.13 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA dx mis.41

*Funzione R.A. el.*

SUB LOTTO 9.2.14 TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SELETTIVA sn mis.41

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, DEAS, SANIC, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta COVIDIEN offre dispositivi contenuti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio: viene ritenuta NON IDONEA.

La ditta DEAS non offre la misura 30CH ma rientra comunque nell'80% delle voci del sub lotto.

E' da ritenersi IDONEA.

La ditta SANIC non offre i progressivi 9.2.3 e 9.2.4. rientra comunque nell'80% delle voci del sub lotto.

Offre inoltre la misura 33CH che rientra comunque nella tolleranza prevista ossia 1mm.

E' da ritenersi IDONEA.

La ditta SMITHS MEDICAL offre dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio: viene ritenuta NON IDONEA.

La ditta TELEFLEX offre, analogamente, dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio: viene ritenuta NON IDONEA.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

61

*Firma di R.A. et al.*

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
DEAS	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI
SANIC	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI

### SUB LOTTO 9.3

#### BLOCCATORE BRONCHIALE

SUB LOTTO 9.3.1 BLOCCATORE BRONCHIALE ADULTI

SUB LOTTO 9.3.2 BLOCCATORE BRONCHIALE BAMBINO

Presentano offerta le ditte CHIRURMEDICA, COOK, TELEFLEX.

La ditta COOK offre dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio: viene considerata NON IDONEA.

La ditta TELEFLEX offre entrambe le voci del lotto. I dispositivi risultano NON RISPONDENTI al richiesto in quanto dotati di due estremità distali già richieste nel sub lotto 9.4.

La ditta CHIRURMEDICA campiona dispositivi RISPONDENTI al richiesto e viene ritenuta IDONEA per tutti le voci offerte.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

*per R.A. L.L.*

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CHIRURMEDICA	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI

**SUB LOTTO 9.4**

**BLOCCATORE BRONCHIALE**

SUB LOTTO 9.4.1 BLOCCATORE BRONCHIALE ADULTI

SUB LOTTO 9.4.2 BLOCCATORE BRONCHIALE BAMBINO

Presenta offerta la ditta TELEFLEX.

I dispositivi risultano rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
TELEFLEX	18 PUNTI	18 PUNTI	17 PUNTI	17 PUNTI	70 PUNTI

*Spun. d. R.A. et.*

**LOTTO 10****MANDRINI E GUIDE MONOUSO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE****SUB LOTTO 10.1****MANDRINO MONOUSO PER INTUBAZIONE**

SUB LOTTO 10.1.1 NEONATALE da I.D. 2,5 a I.D.4mm

SUB LOTTO 10.1.2 PEDIATRICO da I.D. 4 a I.D.6mm

SUB LOTTO 10.1.3 da I.D 6 a I.D.9mm

Presentano offerta le ditte CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, FIMAS, MEDIVAL, SANIC, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX viene esclusa dalla valutazione per incongruenza tra quanto riportato sull'etichetta del campione prodotto dove non compare il simbolo FTALATI e documentazione tecnica dove viene evidenziata la presenza degli stessi; inoltre offre un dispositivo in grado di coprire le misure di tubi con I.D. fino a 5mm.

I dispositivi campionati dalle rimanenti ditte sono da ritenersi IDONEI ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente costruttiva	TOTALE
CONVATEC	18	18	17	17	70 PUNTI

*per F.P.A. C.A.A.*



COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI
DEAS	18	18	17	17	70 PUNTI
FIMAS	12,6	18	12,6	12,6	55,8 PUNTI
MEDIVAL	12,6	18	12,75	12,6	55,95 PUNTI
SANIC	12,6	4,5	4,25	4,25	25,6 PUNTI
SMITHS MEDICAL	18	18	17	17	70 PUNTI

La ditta SANIC raggiunge l'insufficienza nel parametro traumaticità causa l'eccessiva lunghezza del mandrino privo di preformatura prossimale con rischio di fuoriuscita del tubo.

Le ditte FIMAS, MEDIVAL, SANIC raggiungono la sufficienza nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura per la tipologia del materiale e della superficie del mandrino che non consentono un facile inserimento.

Alla ditta SANIC viene attribuita l'insufficienza nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza in quanto il dispositivo campionato presenta scarsa scorrevolezza ed eccessiva memoria.

La differenza di punteggio assegnata alla ditta FIMAS sempre nello stesso parametro è da attribuirsi alla lunghezza del dispositivo che non consente di avere una piegatura prossimale per una facile presa per l'estrazione.

La differenza di punteggio attribuita alla ditta MEDIVAL sempre nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza va attribuita alla minore facilità di scorrimento.

La differenza di punteggio raggiunta dalle ditte SANIC, FIMAS, MEDIVAL nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente è da attribuirsi alla minore facilità di rimodellamento dei dispositivi che comporta un aumento dei tempi di intubazione.

**SUB LOTTO 10.2**

**GUIDA MONOUSO PER INTUBAZIONE DIFFICILE**

*Handwritten signature: RA. ELI*

Presentano offerta le ditte CHIRURMEDICA, FIMAS, TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX offre dispositivi NON RISPONDENTI AL RICHIESTO: campiona infatti scambiatubi anziché guida.

Le ditte CHIRURMEDICA e FIMAS offrono dispositivi rispondenti a quanto richiesto nel capitolato.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CHIRURMEDICA	18	18	17	17	70 PUNTI
FIMAS	12,6	18	4,25	4,25	39,1 PUNTI

Le differenze di punteggio assegnate alla ditta FIMAS nei parametri qualità e resistenza del materiale e della manifattura, qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente, sono da attribuirsi al fatto che il dispositivo campionato si presenta eccessivamente morbido, difficilmente manovrabile per la scarsa rettilineizzazione ed allungamento dei tempi di intubazione che potrebbero compromettere la sicurezza per il paziente trattandosi di intubazione difficile.

### SUB LOTTO 10.3

### GUIDA MONOUSO PER INTUBAZIONE DIFFICILE TIPO FROVA

Presentano offerta le ditte COOK, FIMAS, TELEFLEX.

*per: R. A. el.*  
*AA*

La ditta FIMAS offre dispositivo NON RISPONDEnte AL RICHIESTO: campiona infatti un mandrino per intubazione.

La ditta TELEFLEX offre un dispositivo NON RISPONDEnte AL RICHIESTO in quanto pivo di mandrino adattatore.

La ditta COOK offre un dispositivo RISPONDEnte al richiedo per il ref C-CAE-14.0-70-F11.

Il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	costruttiva aspetti di	TOTALE
COOK	18	18	17	17		70 PUNTI

#### SUB LOTTO 10.4

#### TUBO GUIDA MONOUSO PER SOSTITUZIONE TUBI TRACHEALI E CANNULE(SCAMBIATORE DI TUBI)

SUB LOTTO 10.4.1 Adulti

SUB LOTTO 10.4.2 Pediatrico

SUB LOTTO 10.4.3 Neonatale

Presentano offerta le ditte CHIRURMEDICA, COOK, TELEFLEX.

La ditta CHIRURMEDICA offre le misure neonatale e pediatrica ed è da considerarsi IDONEA.

La ditta TELEFLEX offre tutte e tre le misure ma è da considerarsi IDONEA solamente per le misure adulti e pediatrica.

*RA. CL*  
*ma*

La ditta COOK offre tutte e tre le misure. Per quanto riguarda la misura adulti è da considerarsi rispondente alle esigenze degli utilizzatori il ref CAE-19.0-83: nel complesso è da ritenersi IDONEA per tutte e tre le misure.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente in maggiore corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CHIRURMEDICA	18	18	17	17	70 PUNTI
COOK	18	18	17	17	70 PUNTI
TELEFLEX	18	18	17	17	70 PUNTI

## LOTTO 11

### KIT PER TRACHEOTOMIA

#### SUB LOTTO 11.1

##### KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORI MULTIPLI

SUB LOTTO 11.1.1 KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORI MULTIPLI MIS.7

SUB LOTTO 11.1.2 KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORI MULTIPLI MIS.8

*Handwritten signature and initials:*  
 P.A. cl.  
 [Signature]

Presentano offerta le ditte COOK e TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX offre un dispositivo ritenuto NON IDONEO in quanto contiene ftalati senza che vi sia dichiarazione assenza di rilascio.

I dispositivi offerti dalla ditta COOK sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COOK	18	18	17	17	70 PUNTI

#### SUB LOTTO 11.2

#### KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI

SUB LOTTO 11.2.1 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.5,5

SUB LOTTO 11.2.2 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.6

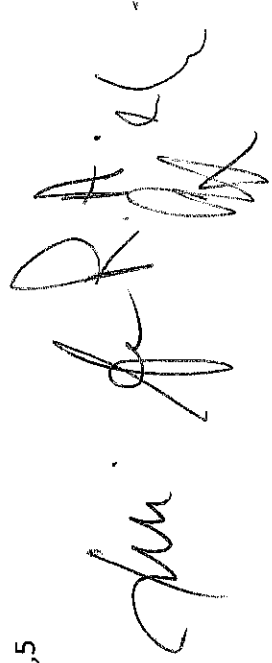
SUB LOTTO 11.2.3 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.6,5

SUB LOTTO 11.2.4 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.7

SUB LOTTO 11.2.5 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.7,5

SUB LOTTO 11.2.6 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.8

SUB LOTTO 11.2.7 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.8,5



SUB LOTTO 11.2.8 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.9

SUB LOTTO 11.2.9 KIT PER TRACHEOSTOMIA TRANSLARINGEA TECNICA TIPO FANTONI MIS.9,5

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 11.3**

**KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORE PROGRESSIVO**

SUB LOTTO 11.3.1 KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORE PROGRESSIVO MISURA 7

SUB LOTTO 11.3.2 KIT PER TRACHEOSTOMIA A DILATATORE PROGRESSIVO MISURA 8

Presenta offerta la ditta TELEFLEX.

La ditta è da ritenersi NON IDONEA per incongruenza tra scheda tecnica ed etichetta del dispositivo: su quest'ultima compare il simbolo degli ftalati mentre sulla documentazione tecnica presentata dalla ditta viene rilevata l'assenza degli stessi senza che vi sia la dichiarazione del non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Spina F.R.A. et al.*

**SUB LOTTO 11.4**

**KIT PER TRACHEOSTOMIA CON PINZA DILATATRICE**

SUB LOTTO 11.4.1 KIT PER TRACHEOSTOMIA CON PINZA DILATATRICE MIS.7

SUB LOTTO 11.4.2 KIT PER TRACHEOSTOMIA CON PINZA DILATATRICE MIS.8

SUB LOTTO 11.4.3 KIT PER TRACHEOSTOMIA CON PINZA DILATATRICE MIS.9

Presentano offerta le ditte DEAS e SMITHS MEDICAL.

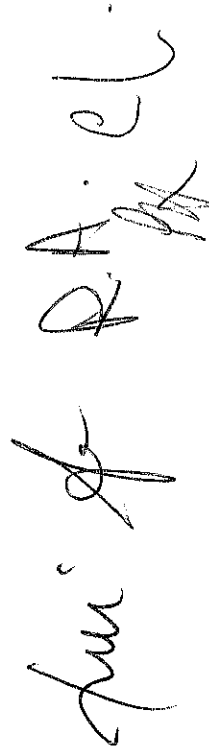
La ditta SMITHS MEDICAL viene ritenuta NON IDONEA in quanto i dispositivi offerti contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

i dispositivi offerti dalla ditta DEAS risultano rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditte	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
DEAS	18	12,6	11,9	17	59,5 PUNTI

La ditta DEAS non raggiunge il massimo nei parametri atraumaticità e qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: ciò è da attribuirsi alla presenza nel kit di una cannula tracheostomica più rigida dovuta all'armatura metallica, priva di un proprio mandrino.

Il dispositivo presenta inoltre un introduttore di plastica rigida e di conseguenza traumatizzante, la pinza fornita presenta, inoltre, una curvatura poco pronunciata.



**SUB LOTTO 11.5**

**KIT PER TRACHEOSTOMIA CON DILATATORE PROGRESSIVO**

SUB LOTTO 11.5.1 KIT PER TRACHEOSTOMIA CON DILATATORE PROGRESSIVO misura 7

SUB LOTTO 11.5.2 KIT PER TRACHEOSTOMIA CON DILATATORE PROGRESSIVO misura 8

SUB LOTTO 11.5.3 KIT PER TRACHEOSTOMIA CON DILATATORE PROGRESSIVO misura 9

Presentano offerta le ditte COOK MEDICAL e SMITHS MEDICAL.

I dispositivi offerti dalla ditta SMITHS MEDICAL vengono considerati NON IDONEI in quanto non rispondenti al richiesto in quanto privi di dilatatore progressivo tramite palloncino.

I dispositivi offerti dalla ditta COOK MEDICAL risultano rispondenti al richiesto per i codici C-PTBS-2100-VT7, C-PTBS-2400-VT8, C-PTBS-2700-VT9.

Il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore corrispondenza massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COOK MEDICAL	18	18	17	17	70 PUNTI

*Luigi R.A. [Signature]*



**LOTTO 12 CANNULE TRACHEOSTOMICHE E ACCESSORI**

**SUB LOTTO 12.1**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY)**

SUB LOTTO 12.1.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY) FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS.5

SUB LOTTO 12.1.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY) FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS.6

SUB LOTTO 12.1.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY) FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS.7

SUB LOTTO 12.1.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY) FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS.8

SUB LOTTO 12.1.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY) FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS.9

SUB LOTTO 12.1.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE(tipo SHILEY) FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS.10

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto si evince la presenza di fralati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 12.2**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY**

73

*fu di R.A. Cl.*

- SUB LOTTO 12.2.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 5
- SUB LOTTO 12.2.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 6
- SUB LOTTO 12.2.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 7
- SUB LOTTO 12.2.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 8
- SUB LOTTO 12.2.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 9
- SUB LOTTO 12.2.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 10

Presentano offerta le ditte CONVATEC, COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta CONVATEC offre dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di controcanula.

Viene ritenuta NON IDONEA.

Le ditte SMITHS MEDICAL e TELEFLEX offrono dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio e pertanto vengono considerate NON IDONEE.

La ditta COVIDIEN offre tutte le misure ed i dispositivi campionati risultano IDONEI.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI

*Handwritten signature: F. A. A. C. A.*

**SUB LOTTO 12.3**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA**

SUB LOTTO 12.3.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.5

SUB LOTTO 12.3.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.6

SUB LOTTO 12.3.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.7

SUB LOTTO 12.3.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.8

SUB LOTTO 12.3.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.9

SUB LOTTO 12.3.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.10

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto si evince la presenza di ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 12.4**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE(TIPO SHILEY) PRIVE DI CUFFIA NON FENESTRATE**

SUB LOTTO 12.4.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.5

SUB LOTTO 12.4.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.6

*per* *di* *R.A. el.*

SUB LOTTO 12.4.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.7

SUB LOTTO 12.4.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.8

SUB LOTTO 12.4.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.9

SUB LOTTO 12.4.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA MIS.10

Presentano offerta le ditte CONVATEC, COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta CONVATEC offre dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di controcanula.

Viene ritenuta NON IDONEA.

Le ditte SMITHS MEDICAL e TELEFLEX offrono dispositivi ritenuti NON IDONEI in quanto contengono fralati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

La ditta COVIDIEN offre tutte le misure richieste ed i dispositivi campionati risultano IDONEI.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI

*Fun. de R.A. G.L.*

**SUB LOTTO 12.5****CONTROCANNULE PER CANNULE TIPO SHILEY DESCRITTE DAL PUNTO 12.1 FINO AL PUNTO 12.4**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

Si fa presente che sono stati valutati esclusivamente i dispositivi delle ditte ritenute idonee nei sub lotti 12.2 e 12.4 nello specifico della ditta COVIDIEN.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI

**SUB LOTTO 12.6****VALVOLE FONATORIE**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE

*mi di R.A. C.L. A*

	maggior valore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	massima attraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	maneggevolezza	paciente	
COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI
SMITHS MEDICAL	18	18	17	17	70 PUNTI
TELEFLEX	18	18	17	17	70 PUNTI

### SUB LOTTO 12.7

#### CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE

SUB LOTTO 12.7.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE MIS.3

SUB LOTTO 12.7.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE MIS.3,5

SUB LOTTO 12.7.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE MIS.4

SUB LOTTO 12.7.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE MIS.4,5

SUB LOTTO 12.7.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE MIS.5

SUB LOTTO 12.7.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE MIS.5,5

Presentano offerta le ditte COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta SMITHS MEDICAL offre un dispositivo privo di mandrino e quindi NON RISPONDENTE analogamente alla ditta TELEFLEX.

La ditta COVIDIEN offre tutte le voci del sub lotto ed i dispositivi risultano rispondenti al richiesto.

Il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del	Attraumaticità(coefficiente	Qualità costruttiva	Qualità costruttiva	TOTALE
-------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------

78

*fun. S. P.A. el. P.A.*

	materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	maggior corrispondenza della massima at traumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	in ergonomia e maneggevolezza	correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	
COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI

**SUB LOTTO 12.8**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE**

SUB LOTTO 12.8.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 4

SUB LOTTO 12.8.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 4,5

SUB LOTTO 12.8.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 5

SUB LOTTO 12.8.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 5,5

Presentano offerta le ditte COVIDIEN e TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX offre dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di mandrino.

La ditta COVIDIEN offre tutte le voci del sub lotto ed i dispositivi campionati risultano rispondenti al richiesto;

Il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il	TOTALE
-------	---	---	---	--	--------

*firm. di R.A. el. M*

COVIDIEN	18	maggior corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	17	maneggevolezza	17	paziente	70 PUNTI
----------	----	---	----	---	----	----------------	----	----------	----------

**LOTTO 13 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE/PROSSIMALMENTE**

**SUB LOTTO 13.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE ED ALTO VOLUME**

SUB LOTTO 13.1.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 6

SUB LOTTO 13.1.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 7

SUB LOTTO 13.1.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 8

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde a tutte e tre le voci del lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

SUB LOTTO 13.2

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE**

*RA. el. RA*  
*mi di*



SUB LOTTO 13.2.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 6

SUB LOTTO 13.2.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 7

SUB LOTTO 13.2.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 8

**Nessuna ditta presenta offerta.**

**SUB LOTTO 13.3**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE**

SUB LOTTO 13.3.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 6

SUB LOTTO 13.3.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 7

SUB LOTTO 13.3.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE DISTALMENTE(TIPO SHILEY) MIS 8

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde a tutte e tre le voci del sub lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 13.4**

**CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFFIA AD ALTA PRESSIONE E BASSO VOLUME**

SUB LOTTO 13.4.1 CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFF. ALTA PRESS. E BASSO VOL. MIS.6

R.A. e C.  
A. P.

SUB LOTTO 13.4.2 CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFF. ALTA PRESS. E BASSO VOL. MIS.7  
SUB LOTTO 13.4.3 CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFF. ALTA PRESS. E BASSO VOL. MIS.8  
SUB LOTTO 13.4.4 CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFF. ALTA PRESS. E BASSO VOL. MIS.9  
SUB LOTTO 13.4.5 CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) CON CUFF. ALTA PRESS. E BASSO VOL. MIS.10

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde alle prime quattro voci del sub lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

#### **SUB LOTTO 13.5**

**CASNNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE**

SUB LOTTO 13.5.1 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE MIS. 6

SUB LOTTO 13.5.2 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE MIS. 7

SUB LOTTO 13.5.3 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE MIS. 8

SUB LOTTO 13.5.4 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE MIS. 9

SUB LOTTO 13.5.5 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE FENESTRATE MIS. 10

**Nessuna ditta presenta offerta.**

*Fun. di R.A.*

*sh*

**SUB LOTTO 13.6**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE**

SUB LOTTO 13.6.1 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE MIS. 6

SUB LOTTO 13.6.2 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE MIS. 7

SUB LOTTO 13.6.3 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE MIS. 8

SUB LOTTO 13.6.4 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE MIS. 9

SUB LOTTO 13.6.5 CANNULETRACHEOSTOMICHE LUNGHE PROSSIMALMENTE(TIPO SHILEY) NON CUFFIATE NON FENESTRATE MIS. 10

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde ai primi quattro progressivi del sub lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 13.7**

**CONTROCANNULE PER CANNULE TIPO SHILEY DESCRITTE DAL PUNTO 13.1 AL PUNTO 13.6**

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

*fine*

*[Signature]*

*R.A.*

*CC*

*[Signature]*

Considerato che i dispositivi dal sub lotto 13.1 a 13.6 sono stati ritenuti NON IDONEI si ritiene di non procedere con la valutazione delle contro cannule(sub lotto 13.7).

**SUB LOTTO 13.8**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE ALTO VOLUME**

SUB LOTTO 13.8.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.5

SUB LOTTO 13.8.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.6

SUB LOTTO 13.8.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.7

SUB LOTTO 13.8.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.8

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde a tutte e quattro le voci del sub lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 13.9**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE NON CUFFIATE**

SUB LOTTO 13.9.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.5

*Fun. J.P.A. et al.*

SUB LOTTO 13.9.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.6

SUB LOTTO 13.9.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.7

SUB LOTTO 13.9.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE DISTALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.8

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde a tutte e quattro le voci del sub lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono fталati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 13.10**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE CON CUFFIA BASSA PRESSIONE ALTO VOLUME**

SUB LOTTO 13.10.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.5

SUB LOTTO 13.10.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.6

SUB LOTTO 13.10.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.7

SUB LOTTO 13.10.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE CUFFIA BASSA PRESS. ALTO VOL. MIS.8

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde a tutte e quattro le voci del sub lotto.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono fталati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Handwritten signature and initials: "F. R.A. 61" and "AA"*

**SUB LOTTO 13.11**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE NON CUFFIATE**

SUB LOTTO 13.11.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE NON CUFFIATEMIS. 5

SUB LOTTO 13.11.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE NON CUFFIATEMIS. 6

SUB LOTTO 13.11.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE NON CUFFIATEMIS. 7

SUB LOTTO 13.11.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO LUNGHE PROSSIMALMENTE NON CUFFIATEMIS. 8

Presenta offerta la ditta COVIDIEN che risponde a tutte le voci del lotto:

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di assenza di rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 13.12**

**CONTROCANNULE PER CANNULE DESCRITTE DAL PUNTO 13.8 AL PUNTO 13.11**

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

Considerato che i dispositivi dal sub lotto 13.8 a 13.11 sono stati ritenuti NON IDONEI si ritiene di non procedere con la valutazione delle contro cannule(sub lotto 13.12).

*RA.*  
*Qui de RA.*

**LOTTO 14**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO**

**SUB LOTTO 14.1**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO**

SUB LOTTO 14.1.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 5

SUB LOTTO 14.1.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 5,5

SUB LOTTO 14.1.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 6

SUB LOTTO 14.1.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 6,5

SUB LOTTO 14.1.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 7

SUB LOTTO 14.1.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 7,5

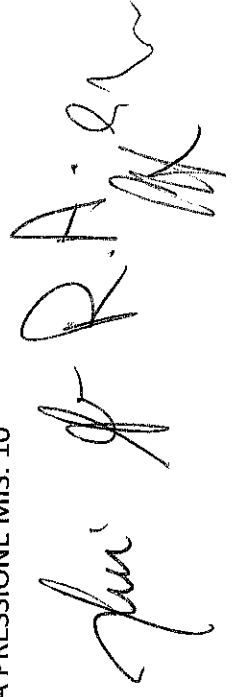
SUB LOTTO 14.1.7 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 8

SUB LOTTO 14.1.8 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 8,5

SUB LOTTO 14.1.9 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 9

SUB LOTTO 14.1.10 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 9,5

SUB LOTTO 14.1.11 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE MIS. 10



Presentano offerta le ditte SANIC e TELEFLEX.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

SUB LOTTO 14.2

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO**

SUB LOTTO 14.2.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 3

SUB LOTTO 14.2.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 3,5

SUB LOTTO 14.2.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 4

SUB LOTTO 14.2.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 4,5

SUB LOTTO 14.2.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 5

SUB LOTTO 14.2.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 5,5

SUB LOTTO 14.2.7 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 6

SUB LOTTO 14.2.8 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 6,5

SUB LOTTO 14.2.9 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 7

SUB LOTTO 14.2.10 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 7,5

SUB LOTTO 14.2.11 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 8

*Yuri*  
*R.A.*  
*CU*



- SUB LOTTO 14.2.12 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 8,5
- SUB LOTTO 14.2.13 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 9
- SUB LOTTO 14.2.14 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 9,5
- SUB LOTTO 14.2.15 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON CUFFIATE MIS. 10

Presenta offerta la ditta TELEFLEX .

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

#### **SUB LOTTO 14.3**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO FENESTRATE**

Nessuna ditta presenta offerta.

#### **SUB LOTTO 14.4**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO NON FENESTRATE**

*Handwritten signature and initials:*  
Pini  
P.A. P.C.

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 14.5**

**CONTROCANNULE PER LE CANNULE PREVISTE DAL SUB LOTTO 14.1 AL SUB LOTTO 14.4**

Nessuna ditta presenta offerta.

**LOTTO 15**

**CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE E ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE**

SUB LOTTO 15.1.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 6

SUB LOTTO 15.1.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 6,5

SUB LOTTO 15.1.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 7

SUB LOTTO 15.1.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 7,5

SUB LOTTO 15.1.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 8

SUB LOTTO 15.1.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 8,5

SUB LOTTO 15.1.7 CANNULE TRACHEOSTOMICHE TRASPARENTI MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA C. B. P. MIS. 9

SUB LOTTO 15.1.8 LINEA DI ASPIRAZIONE LUNGHEZZA 150CM CIRCA

*Giulio P.A. el.*

SUB LOTTO 15.1.9 FILTRO IDROFOBICO PER SISTEMA DI ASPIRAZIONE

SUB LOTTO 15.1.10 RESERVOIR MONOUSO PER SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Presenta offerta la ditta COVIDIEN.

I dispositivi offerti vengono ritenuti NON IDONEI in quanto contengono ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

## **LOTTO 16**

### **CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE**

SUB LOTTO 16.1.1 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.6

SUB LOTTO 16.1.2 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.6,5

SUB LOTTO 16.1.3 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.7

SUB LOTTO 16.1.4 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.7,5

SUB LOTTO 16.1.5 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.8

SUB LOTTO 16.1.6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.8,5

SUB LOTTO 16.1.7 CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO E CONTROCANNULE MIS.9

**Nessuna ditta presenta offerta.**

*Man. de R.A. 21-*

## **SUB LOTTO 16.2 CONTROCANNULE DESCRITTE NEL SUB LOTTO 16.1**

Nessuna ditta presenta offerta.

## **LOTTO 17 SISTEMI E DISPOSITIVI PER L'ASPIRAZIONE TRACHEO-BRONCHIALE**

### **SUB LOTTO 17.1**

#### **SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER TUBI**

SUB LOTTO 17.1.1 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER TUBI CH 12

SUB LOTTO 17.1.2 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER TUBI CH 14

SUB LOTTO 17.1.3 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER TUBI CH 16

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, MEDISIZE, MEDIVAL.

La ditta ALFAMED campiona un dispositivo privo di catetere mount e pertanto **NON RISPONDE** al richiesto.

La ditta viene, pertanto, esclusa dalla valutazione.

La ditta MEDISIZE offre un dispositivo in cui l'adattatore **VERSO** non risulta sterile e pertanto è da ritenersi **NON IDONEO**. Non vengono inoltre indicati CND e Repertorio del catetere MOUNT.

Le ditte COVIDIEN e MEDIVAL vengono ritenute **NON IDONEE** in quanto offrono dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Luigi de R.A. [Signature]*

**SUB LOTTO 17.2**

**SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER CANNULE**

SUB LOTTO 17.2.1 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER CANNULE CH 12

SUB LOTTO 17.2.2 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER CANNULE CH 14

SUB LOTTO 17.2.3 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER CANNULE CH 16

SUB LOTTO 17.2.3 SISTEMA D'ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER CANNULE CH 18

Presentano offerta le ditte ALFAMED, COVIDIEN, MEDISIZE.

La ditta ALFAMED campiona un dispositivo privo di catetere mount e pertanto **NON RISPONDE** al richiesto.

La ditta viene, pertanto, esclusa dalla valutazione.

La ditta MEDISIZE offre un dispositivo in cui l'adattatore **VERSO** non risulta sterile e pertanto è da ritenersi **NON IDONEO**. Non vengono inoltre indicati CND e Repertorio del catetere MOUNT.

La ditta COVIDIEN viene ritenuta **NON IDONEA** in quanto offre dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 17.3**

*Qui: R.A. EN*  
*di: [signature]*

## SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE

SUB LOTTO 17.3.1 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 6

SUB LOTTO 17.3.2 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 8

SUB LOTTO 17.3.3 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 10

SUB LOTTO 17.3.4 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 12

SUB LOTTO 17.3.5 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 14

SUB LOTTO 17.3.6 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 16

SUB LOTTO 17.3.7 SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CH 18

Presentano offerta le seguenti ditte: AIR LIQUID, BENEFIS, CONVATEC, COVIDIEN, DEAS, DIEMME, ID&CO, SANIC, SECURMED, TAU MEDICA, TELEFLEX.

La ditta TAU MEDICA presenta documentazione tecnica dalla quale si evince la presenza di ftalati senza che siano evidenziati in etichetta come previsto dalla normativa vigente. Viene pertanto ritenuta NON IDONEA.

Analogamente la ditta SECURMED viene ritenuta NON IDONEA per incongruenza tra documentazione tecnica in cui sulla fotocopia dell'etichetta vengono evidenziati gli ftalati ed etichetta del campione prodotto dove gli stessi non vengono evidenziati.

La ditta SANIC viene ritenuto NON IDONEA in quanto offre un dispositivo contenente ftalati senza che vi sia la dichiarazione di non rilascio.

Le ditte AIR LIQUID, BENEFIS, COVIDIEN offrono dispositivi contenenti ftalati senza che vi sia dichiarazione di non rilascio e pertanto vengono ritenute NON IDONEE.

Le rimanenti ditte offrono dispositivi rispondenti al richiesto.

La ditta TELEFLEX non offre il progressivo 1 del sub lotto: rientra comunque nell'80% delle voci richieste.

*per R.A. S.S.*

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore corrispondenza massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CONVATEC	18	18	17	17	70 PUNTI
DEAS	18	18	17	17	70 PUNTI
DIEMME	18	18	17	17	70 PUNTI
ID&CO	18	18	17	17	70 PUNTI
TELEFLEX	18	18	17	17	70 PUNTI

#### SUB LOTTO 17.4

#### DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE

Presentano offerta le ditte BENEFIS, DEAS, MEDIVAL, SANIC.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e	Atraumaticità(coefficiente maggiore corrispondenza massima atraumaticità su valutazione della	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE

*per P.A. AR(-)*

	resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Commissione tecnica)	
BENEFIS	18	18	17
DEAS	18	18	17
MEDIVAL	18	18	17
SANIC	18	18	17

## LOTTO 18 MISCELLANEA

### SUB LOTTO 18.1

#### FASCIA FISSAGGIO TUBI ENDOTRACHEALI ORO/NASALE

SUB LOTTO 18.1 FASCIA FISSAGGIO TUBI ENDOTRACHEALE NEONATALE

SUB LOTTO 18.2 FASCIA FISSAGGIO TUBI ENDOTRACHEALE PEDIATRICO

SUB LOTTO 18.3 FASCIA FISSAGGIO TUBI ENDOTRACHEALE ADULTO

Presentano offerta le ditte BIOPSYBELL, COVIDIEN, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

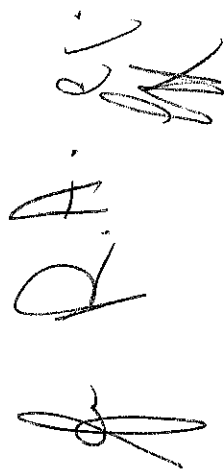

La ditta BIOPSYBELL offre un dispositivo idoneo per il fissaggio di cannula tracheostomica e non idoneo per il fissaggio di tubi endotracheali in quanto privo di foro e non idoneo per il fissaggio dietro la nuca.

La ditta COVIDIEN offre analogamente un dispositivo adatto per il fissaggio di cannula tracheostomica e non idoneo per tubi endotracheali come si evince anche dalla documentazione tecnica.

La ditta SMITHS MEDICAL non offre un dispositivo per il fissaggio dietro la nuca come richiesto e pertanto risulta NON IDONEA.

La ditta TELEFLEX offre un dispositivo per il fissaggio di cannule di guedel e biteblock e non idoneo per tubi endotracheali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*qui*  



**SUB LOTTO 18.2**

**UMIDIFICATORE A CONDENSATORE IGROSCOPICO(NASO ARTIFICIALE)**

SUB LOTTO 18.2.1 UMIDIFICATORE A CONDENSATORE IGROSCOPICO NEONATALE

SUB LOTTO 18.2.2 UMIDIFICATORE A CONDENSATORE IGROSCOPICO PEDIATRICO

SUB LOTTO 18.2.3 UMIDIFICATORE A CONDENSATORE IGROSCOPICO ADULTO

Presentano offerta le ditte AIR LIQUID, BIOPSYBELL, COVIDIEN, DEAS, FIMAS.

La ditta FIMAS offre un dispositivo privo di foro per consentire l'aspirazione e pertanto viene ritenuta **NON IDONEA**.

La ditta AIR LIQUID risponde al progressivo 1 ed ai progressivi 2 e 3 con un dispositivo unico: viene ritenuta **IDONEA**.

La ditta BIOPSYBELL offre un dispositivo unico per il progressivo 2 e 3 : viene ritenuta **IDONEA**.

La ditta COVIDIEN non offre il progressivo 1 e per i progressivi 2 e 3 offre lo stesso dispositivo: viene ritenuta **IDONEA** in quanto riesce a coprire le esigenze delle due tipologie di pazienti..

La ditta DEAS offre tutti e tre i progressivi del lotto: viene ritenuta **IDONEA**.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza materiale e della	del la	Atraumaticità(coefficiente in maggiore	Qualità correlata ad aspetti di	costruttiva ad aspetti di	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di	TOTALE
-------	---	-----------	--	---	------------------------------------	---	--------

*plus*  
*R.A.C.I.*

	manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	corrispondenza della massima attrattività su valutazione della Commissione tecnica)	ergonomia e maneggevolezza	e sicurezza paziente	per il
AIR LIQUID	18	18	17	12,75	65,75 PUNTI
BIOPSYBELL	18	18	17	12,75	65,75 PUNTI
COVIDIEN	18	18	17	17	70 PUNTI
DEAS	18	18	17	12,75	65,75 PUNTI

La differenza di punteggio ottenuta nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente è da attribuirsi alla presenza nel dispositivo campionato dalla ditta COVIDIEN di un foro di aspirazione richiudibile.

#### SUB LOTTO 18.3

**DISTANZIATORE PER AEROSOL DOSATO ADATTABILE A CIRCUITI PER VENTILAZIONE MECCANICA**

**NESSUNA DITTA PRESENTA OFFERTA.**

#### SUB LOTTO 18.4

**VALVOLA PEEP**

SUB LOTTO 18.4.1 VALVOLA PEEP DI TIPO REGOLABILE

SUB LOTTO 18.4.2 VALVOLA PEEP DI TIPO PRE-TARATO

Presentano offerta le ditte AMBU e DIMAR.

*Spini for R.A. et al.*

La ditta DIMAR presenta solamente documentazione tecnica senza campionatura e senza che l'elenco dei dispositivi offerti contenesse tale lotto. Viene esclusa dalla valutazione per incongruenza.

La ditta AMBU offre un dispositivo rispondente al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
AMBU	18	18	17	17	70 PUNTI

**SUB LOTTO 18.5**

**PALLOINE IN SILICONE RIUTILIZZABILE**

SUB LOTTO 18.5.1 PALLOINE IN SILICONE RIUTILIZZABILE CAPACITA' litri 0,5

SUB LOTTO 18.5.2 PALLOINE IN SILICONE RIUTILIZZABILE CAPACITA' litri 1

SUB LOTTO 18.5.3 PALLOINE IN SILICONE RIUTILIZZABILE CAPACITA' litri 2

SUB LOTTO 18.5.4 PALLOINE IN SILICONE RIUTILIZZABILE CAPACITA' litri 3

Presentano offerta le seguenti ditte: AMBU, CHIRURMEDICA, FIMAS, HAROL, TELEFLEX.

La ditta AMBU offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto non risulta bivalva e non presenta anello di sospensione. Viene pertanto ritenuta NON IDONEA.

Handwritten signature and initials, possibly 'F. A. A. L.' and 'R. A. A. L.', with a large flourish on the right side.

Le rimanenti ditte rispondono a tutti e quattro i progressivi del sub lotto ed i dispositivi sono rispondenti.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CHIRURMEDICA	18	18	17	17	70 PUNTI
FIMAS	18	18	12,75	12,75	61,5 PUNTI
HAROL	18	18	17	12,75	65,75 PUNTI
TELEFLEX	18	18	17	17	70 PUNTI

La differenza di punteggio ottenuta nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente è da attribuirsi alla maggiore lunghezza della bacchetta per l'attacco che garantisce una maggiore tenuta del raccordo per i dispositivi campionati dalle ditte CHIRURMEDICA e TELEFLEX.

La differenza di punteggio ottenuta nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza va attribuita alla superficie più scivolosa del dispositivo offerto dalla ditta FIMAS.

SUB LOTTO 18.6

SET PER LA INFILTRAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA

*Handwritten signature: "P. A. A. A." with a large flourish.*

SUB LOTTO 18.6.1 SET CON AGO 19G CIRCA LUNGHEZZA CATETERE 25MM CIRCA  
 SUB LOTTO 18.6.2 SET CON AGO 19G CIRCA LUNGHEZZA CATETERE 65MM CIRCA  
 SUB LOTTO 18.6.3 SET CON AGO 19G CIRCA LUNGHEZZA CATETERE 100MM CIRCA  
 SUB LOTTO 18.6.4 SET CON AGO 19G CIRCA LUNGHEZZA CATETERE 150MM CIRCA  
 SUB LOTTO 18.6.5 SET CON AGO 19G CIRCA LUNGHEZZA CATETERE 300MM CIRCA  
 SUB LOTTO 18.6.6 SET CON AGO 19G CIRCA LUNGHEZZA CATETERE 400MM CIRCA

Presentano offerta le ditte MOVl, MEDIVAL, PLAN1HEALTH, TSS MEDICAL.

La ditta MEDIVAL offre dispositivi ritenuti NON IDONEI per la presenza di ftalati.

La ditta MOVl non offre il progressivo 6: viene comunque ritenuta IDONEA.

La ditta PLAN 1 HEALTH offre un dispositivo della stessa misura per i progressivi 2 e 3: lo stesso viene ritenuto IDONEO solo per il progressivo 3.

Non offre il progressivo 6. Rientra comunque nell'80% delle voci del sub lotto. E' da ritenersi IDONEA.

La ditta TSS MEDICAL offre tutti i progressivi del sub lotto e gli stessi vengono ritenuti IDONEI.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
MOVl	18	18	17	17	70 PUNTI
PLAN 1 HEALTH	18	18	17	17	70 PUNTI

*Fun. R.A. di A.*

TSS MEDICAL	18	18	17	17	70 PUNTI
-------------	----	----	----	----	----------

**SUB LOTTO 18.7**

**DISPOSITIVO PER SOMMINISTRAZIONE TOPICA DI ANESTETICI LOCALI**

Presentano offerta le ditte DIMAR e TELEFLEX.

La ditta DIMAR offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto sprovvisto di memoria e quindi non idoneo per le esigenze degli utilizzatori.

La ditta TELEFLEX offre un dispositivo non sterile e pertanto non rispondente a quanto richiesto nel capitolato.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 18.8**

**CATETERE INTESTINALE A PERMANENZA PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA FECALE**

Presentano offerta le ditte SBM e CONVATEC.

I dispositivi offerti dalla ditta SBM risultano **NON IDONEI** in quanto contengono ftalati senza che vi sia la dichiarazione di assenza di rilascio.

I dispositivi offerti dalla ditta CONVATEC sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

*fine* *R.A.eli* *AK*

CONVATEC	18	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	17	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE	70 PUNTI
----------	----	--	----	--	----	--	----	---	--------	----------

**SUB LOTTO 18.9**

**DISPOSITIVO PER LA PULIZIA DELLA LINGUA**

Presentano offerta le ditte DEAS e FIMAS.

La ditta DEAS offre un dispositivo in gomma piuma con superficie non abrasiva e pertanto non rispondente al richiesto.

La ditta FIMAS offre un dispositivo rispondente al richiesto.

Il punteggio assegnato è il seguente:

FIMAS	18	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	Atraumaticità (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	17	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE	70 PUNTI
-------	----	--	----	--	----	--	----	---	--------	----------

*Aut. di P.A. di C.L. - [Signature]*

SUB LOTTO 18.10

APRIBOCCA

Nessuna ditta presenta offerta.

**LOTTO 19 CATETERI VENOSI CENTRALI PER ADULTI**

SUB LOTTO 19.1 SET CVC MONOLUME 14GX16CM circa

SUB LOTTO 19.2 SET CVC MONOLUME 16GX16 CM CIRCA

SUB LOTTO 19.3 SET CVC MONOLUME 16GX20 CM circa

SUB LOTTO 19.4SET CVC BILUME 4Fr- 22/22GX8 CM circa

SUB LOTTO 19.5 SET CVC BILUME 8Fr-14/14GX20CM circa

SUB LOTTO 19.6SET CVC BILUME 8Fr-14/14GX16 CM circa

SUB LOTTO 19.7 SET CVC BILUME 8Fr-14/18GX16 CM circa

SUB LOTTO 19.8 SET CVC TRILUME 8,5Fr-14/16/16 CM circa

SUB LOTTO 19.9 SET CVC TRILUME 8,5Fr-14/16/16 X20 CM circa

SUB LOTTO 19.10 SET CVC TRILUME 7Fr- 16/18/18GX20 CM circa

SUB LOTTO 19.11SET CVC A QUATTRO LUMI 8,5 Fr- 14/16/18/18g X16 CM circa

SUB LOTTO 19.12 SET CVC A QUATTRO LUMI 8,5Fr- 14/16/18/18G X20 CM circa

*Man*  
*R.A. et.*  
*RA*



**SUB LOTTO 19.13 SET CVC A CINQUE LUMI 8,5Fr-14/16/18/18/18G X16CM circa**

Presentano offerta le ditte ALFAMED, B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARE, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

La ditta ALFAMED viene ritenuta NON IDONEA per etichetta non conforme alla normativa vigente: risulta priva del riferimento della figura del responsabile dell'immissione in commercio o del mandatario del fabbricante.

La ditta CORMED CARDIOVASCOLARE presenta offerta per i sub lotti da 1 a 12.

Risulta NON RISPONDENTE per i sub lotti 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10 in quanto il calibro interno dei lumi si discosta dal richiesto: non rientra, pertanto, nell'80%.

La ditta SMITHS MEDICAL presenta offerta per i sub lotti da 2 a 13.

Viene considerata NON IDONEA in quanto i dispositivi offerti sono privi di siringa di Raulerson.

La ditta B.BRAUN presenta offerta per tutti i sub lotti tranne il 4.

Viene considerata NON IDONEA in quanto priva di siringa di Raulerson; inoltre per i sub lotti 5, 6, 8, 9 il calibro interno dei lumi si discosta dal richiesto.

La ditta TELEFLEX presenta offerta per tutti i sub lotti.

Viene considerata NON IDONEA per i sub lotti 4, 6, 13 in quanto i dispositivi offerti sono privi di siringa di RAULERSON.

Tuttavia essendo IDONEI numero 10 sub lotti su 13 rientra nell'80%.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente)	Atraumaticità(coefficiente maggiore corrispondenza della	Qualità correlata ad ergonomia	costruttiva aspetti di e	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza e	costruttiva aspetti di per il	TOTALE
-------	--	--	--------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	--------

*Handwritten signature: M. A. R.A.*

	maggior corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	18	maneggevolezza	17	paziente	17	70 PUNTI
TELEFLEX		18		18		17		17	

**LOTTO 20 CATETERI VENOSI CENTRALI PEDIATRICI**

SUB LOTTO 20.1 SET CVC MONOLOLUME 20GX13CM

SUB LOTTO 20.2SET CVC MONOLOLUME 20GX8CM

SUB LOTTO 20.3 SET CVC MONOLOLUME 24GX9CM

SUB LOTTO 20.4 SET CVC BILUME 18/20GX13CM

SUB LOTTO 20.5 SET CVC BILUME 22/22GX5CM

SUB LOTTO 20.6 SET CVC BILUME 22/22GX8CM

SUB LOTTO 20.7 SET CVC BILUME 22/22GX13CM

SUB LOTTO 20.8 SET CVC TRILUME 20/22/22GX8CM

SUB LOTTO 20.9 SET CVC TRILUME 20/22/22GX13CM

SUB LOTTO 20.10 ET CVC TRILUME 20/22/22GX5CM

Presentano offerta le ditte ALFAMED, SMITHS MEDICAL, TELEFLEX.

*Handwritten signatures:*  
 R.A.  
 Full  
 C.L.  
 A.A.

La ditta SMITHS MEDICAL non offre i dispositivi del sub lotto 20.1; viene considerata NON IDONEA per i dispositivi dei rimanenti sub lotti in quanto non c'è possibilità di inserimento della guida senza deconnettere la siringa.

Inoltre la guida metallica non è a.l.

La ditta ALFAMED non offre i dispositivi del sub lotto 20.3., viene ritenuta NON IDONEA per etichetta non conforme alla normativa vigente: risulta priva del riferimento della figura del responsabile dell'immissione in commercio o del mandatario del fabbricante.

la ditta TELEFLEX non offre i dispositivi del sub lotto 2; viene ritenuta tuttavia NON IDONEA in quanto il catetere risulta privo di marcature di profondità e non c'è possibilità di inserimento della guida senza deconnettere la siringa.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

## **LOTTO 21**

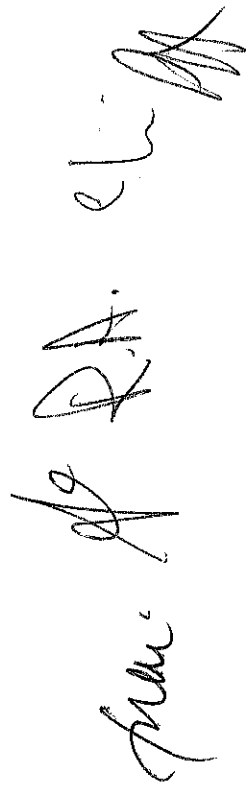
**MASCHERA TRASPARENTE MONOUSO PER INTUBAZIONE, A FIBRE OTTICHE, PER GASTROENTEROLOGIA CON TAPPO IN SILICONE CON FORO DA 10MM**

**SUB LOTTO 21.1 MASCHERA TRASPARENTE MONOUSO PER INTUBAZIONE, A FIBRE OTTICHE, PER GASTROENTEROLOGIA CON TAPPO IN SILICONE CON FORO DA 10MM MISURA 4**

**SUB LOTTO 21.2 MASCHERA TRASPARENTE MONOUSO PER INTUBAZIONE, A FIBRE OTTICHE, PER GASTROENTEROLOGIA CON TAPPO IN SILICONE CON FORO DA 10MM MISURA 5**

**SUB LOTTO 21.3 MASCHERA TRASPARENTE MONOUSO PER INTUBAZIONE, A FIBRE OTTICHE, PER GASTROENTEROLOGIA CON TAPPO IN SILICONE CON FORO DA 10MM MISURA 6**

Presenta offerta la ditta TELEFLEX.



Il dispositivo offerto dalla ditta risulta RISPONDENTE al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
TELEFLEX	18	18	17	17	17	70 PUNTI

**LOTTO 22 AGHI DA SPINALE EPERIDURALE(AGGIUDICAZIONE A SINGOLO PUNTO)**

(con sistema di sicurezza per la prevenzione delle punture accidentali)

SUB LOTTO 22.1. AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE

SUB LOTTO 22.1.1




AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 18GX90MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.2

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 19GX90MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

*R.A. cl*  
  
  


SUB LOTTO 22.1.3

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 20GX90MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.4

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 22GX90MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.5

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 23GX90MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.6

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 25GX90MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.7

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 27GX90MM CIRCA

*fu*

*R.A. EV*

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.8

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 22GX180MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.1.9

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE CON INTRODUTTORE 20GX40MM CIRCA

Nessuna ditta presenta offerta.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

SUB LOTTO 22.2 AGO SPINALE DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE

SUB LOTTO 22.2.1

AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 18GX90MM CIRCA

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

110

*M. de R.A.C.I. - R*

**SUB LOTTO 22.2.2**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 19GX90MM CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.2.3**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 20GX90MM CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.2.4**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 22GX90MM CIRCA**

111

*Giulio R.A. C.L.*

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.2.5**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 23GX90MM CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.2.6**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 25GX90MM CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*pm* *di R.A. cl.* *JA*



**SUB LOTTO 22.2.7**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 27GX90MM CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN e DIEMME.

Entrambe le ditte offrono un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.2.8**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 22GX180MM CIRCA**

Presenta offerta la ditta B.BRAUN.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.2.9**

**AGO SPINALE PUNTA DI QUINCKE SENZA INTRODUTTORE 20GX40MM CIRCA**

Presenta offerta la ditta B.BRAUN.

*Spina di R.A. et al.*

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3 AGO SPINALE PUNTA WHITACRE CON INTRODUTTORE**

**SUB LOTTO 22.3.1**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 22GX38MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.2**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 22GX90MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*per R.A.*  
*EL*  
*PA*

**SUB LOTTO 22.3.3**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 22GX103MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.4**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 22GX120MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Ma*  
*R.A. Elia*

**SUB LOTTO 22.3.5**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 25GX38MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.6**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 25GX90MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.


La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.7**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 25GX103MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

*R.A. el s*  
*Tom J* 

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.8**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 25GX120MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.9**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 27GX38MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Per R.A. el. A*

**SUB LOTTO 22.3.10**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 27GX90MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.11**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 27GX103MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.3.12**

**AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 27GX120MM**

Presenta offerta la ditta ARCHIS.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

*M. F. R.A. ELA*

PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.

SUB LOTTO 22.3.13

AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 29GX38MM

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.3.14

AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 29GX90MM

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.3.15

AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 29GX103MM

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.3.16

AGO SPINALE PUNTA WHITACRE 29GX120MM

Nessuna ditta presenta offerta.

*per R.A. el SA*

**SUB LOTTO 22.4 AGO SPINALE PUNTA SPROTTE CON INTRODUTTORE**

**SUB LOTTO 22.4.1**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 22GX35MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.2**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 22GX70MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.3**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 22GX90MM**

120

*Guido R. A. e. c.*

*W*



Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.4**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 22GX103MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.5**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 22GX120MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Fun. di R.A. el -*  
*[Signature]*

**SUB LOTTO 22.4.6**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 22GX150MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.7**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 22GX200MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.8**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 24GX35MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

*per R.A. C.I.*

*AK*

**SUB LOTTO 22.4.9**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 24GX70MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.10**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 24GX90MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.11**

123

*per R.A. Ricci*

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 24GX103MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.12**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 24GX120MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.


**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.13**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 24GX150MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

*Spina di R.A. el.*



**SUB LOTTO 22.4.14**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 24GX200MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.15**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 25GX35MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.16**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 25GX70MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.17**

125

*Fu. A. R.A. e l. A.*

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 25GX90MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.18**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 25GX103MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.19**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 25GX120MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

*John de R.A. cal*

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.20**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 25GX150MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.21**

**AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 25GX200MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.22**

127

*Firma di R.A. el. H*

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX35MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.23**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX70MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.24**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX90MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Handwritten signature: Paolo de R.A. cl. A*



**SUB LOTTO 22.4.25**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX103MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.26**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX120MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

La ditta offre un dispositivo **NON RISPONDENTE** al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.4.27**

129

*Fun. R.A. Clini*

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX150MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.28**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 27GX200MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.29**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 29GX35MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.30**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 29GX70MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.4.31**

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 29GX90MM**

Presenta offerta la ditta MOVI.

*Fun. de*  
*R.A.*  
*e l. M*

La ditta offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto privo di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.

SUB LOTTO 22.4.32

AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 29GX103MM

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.4.33

AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 29GX120MM

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.4.34

AGO SPINALE PUNTA SPOTTE 29GX150MM

Nessuna ditta presenta offerta.

SUB LOTTO 22.4.35

*per R.A. cl*

**AGO SPINALE PUNTA SPROTTE 29GX200MM**

Nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.5**

**AGO SPINALE PUNTA TUOHY**

Da 22.5.1 a 22.5.10 nessuna ditta presenta offerta.

**SUB LOTTO 22.6**

**SET ANESTESIA EPIDURALE AGO TUOHY 16G**

Presentano offerta le seguenti ditte: B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, DIEMME, ESAFARMA, MOVI, TELEFLEX.

Le ditte offrono dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 22.7**

**SET ANESTESIA EPIDURALE AGO TUOHY 18G**

*Per R.A. el*

Presentano offerta le seguenti ditte: ARCHIS, BECTON&DICKINSON, B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, DIEMME, ESAFARMA, MOVI, TELEFLEX, TSS MEDICAL.

Le ditte offrono dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

#### **SUB LOTTO 22.8**

##### **SET ANESTESIA COMBINATA SPINALE-EPIDURALE**

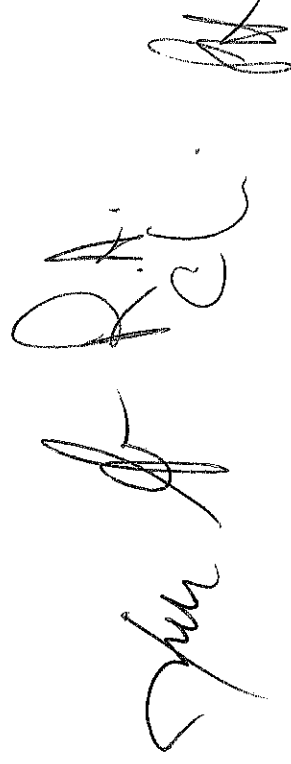
Presentano offerta le seguenti ditte: BECTON&DICKINSON, B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, DIEMME, ESAFARMA, MOVI, TELEFLEX.

Le ditte offrono dispositivi NON RISPONDENTI al richiesto in quanto privi di meccanismo di sicurezza contro le punture accidentali.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

#### **LOTTO 23 DISPOSITIVI VARI**

**SUB LOTTO 23.1 SET DIURESIS ORARIA/SACCHE DI RICAMBIO SET DIURESIS ORARIA**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P. A. C. L.' with a flourish at the end.

**SUB LOTTO 23.1.1.SET DIURESI ORARIA**

**SUB LOTTO 23.1.2 SACCHE DI RICAMBIO SET DIURESI ORARIA**

Presentano offerta le seguenti ditte: B.BRAUN, BENEFIS, CHIRURMEDICA, CONVATEC, COVIDIEN, SECURMED, TAU MEDICA, TELEFLEX.

Le ditte B.BRAUN, BENEFIS, CHIRURMEDICA, COVIDIEN, SECURMED, TAU MEDICA e TELEFLEX essendo prive di valvola di non ritorno nel connettore vengono ritenute NON IDONEE.

La ditta CONVATEC offre un dispositivo RISPONDENTE al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CONVATEC	25	23	22	70 PUNTI

**SUB LOTTO 23.2 TELINO STERILE PER MICROSCOPIO OPERATORIO**

Presentano offerta le ditte ESAFARMA, ESOFORM, FASE, ID&CO, MEDLINE, CARL ZEISS.

Il dispositivo offerto dalla ditta ID&CO viene ritenuto NON IDONEO in quanto la copertura degli oculari è priva di fissaggio in velcro così com'erichiesto.

*Handwritten signature and initials: "Fur" and "P.A. e L.P.A."*

I dispositivi offerti dalle ditte ESOFORM e MEDLINE sono da ritenersi NON IDONEI in quanto durante le manovre al microscopio sono stati soggetti a rottura sotto tensione.

Le rimanenti ditte hanno offerto dispositivi RISPONDENTI al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditte	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CARL ZEISS	17,5	23	16,5	57 PUNTI
ESAFARMA	18,75	23	16,5	58,25 PUNTI
FASE	18,75	23	16,5	58,25 PUNTI

Il dispositivo offerto dalla ditta CARL ZEISS risulta dotato di minore resistenza sotto tensione durante le manovre al microscopio.

**SUB LOTTO 23.3**

**MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA, CON RELATIVI ELETTRODI MONOUSO, STERILI.**

**SUB LOTTO 23.3.1 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,**

**LUNGHEZZA 70 MM, A LAMA**

**SUB LOTTO 23.3.2 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,**

**LUNGHEZZA 50 MM, CON LAMA PROTETTA FINO A 6 MM DALLA PUNTA**

*Handwritten signature: R.A. el*

SUB LOTTO 23.3.3 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,  
LUNGHEZZA 70 MM, A PALLINA DIAMETRO 4 MM

SUB LOTTO 23.3.4 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,  
LUNGHEZZA 70 MM, A LAMA

SUB LOTTO 23.3.5 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,  
LUNGHEZZA 70 MM, AD AGO

SUB LOTTO 23.3.6 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,  
LUNGHEZZA 70 MM, CON AGO PROTETTO FINO A 6 MM DALLA PUNTA

SUB LOTTO 23.3.7 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, CORTO,  
LUNGHEZZA 70 MM, A PALLINA DIAMETRO 2-3 MM

SUB LOTTO 23.3.8 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, LUNGO,  
LUNGHEZZA 150 MM, A LAMA

SUB LOTTO 23.3.9 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, LUNGO,  
LUNGHEZZA 150 MM, CON LAMA PROTETTA FINO A 6 MM DALLA PUNTA

SUB LOTTO 23.3.10 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, LUNGO,  
LUNGHEZZA 150 MM, AD AGO

SUB LOTTO 23.3.11 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE, LUNGO,  
LUNGHEZZA 150 MM, A PALLINA DIAMETRO 4 MM

*Spina. J. R.A. cl. fit*



**SUB LOTTO 23.3.12 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE,**

**LUNGHEZZA 70 MM, CON PUNTO ANTI-ESCARA AD AGO**

**SUB LOTTO 23.3.13 MANIPOLI MONOUSO STERILI CON COMANDO MANUALE PER ELETTROCHIRURGIA CON ELETTRODO RIMOVIBILE,**

**LUNGHEZZA 150 MM, CON PUNTO ANTI-ESCARA A LAMA**

Presentano offerta le seguenti ditte: ALEA, FASE, FIAB, ID&Co, TAU MEDICA.

La ditta ALEA offre tutti i progressivi del sub lotto; viene ritenuta NON IDONEA in quanto il dispositivo presenta un attacco non compatibile con gli elettrobisturi in dotazione dell'Azienda ASL Pescara.

La ditta ID&Co non offre i progressivi 3, 7, 11. Risulta NON RISPONDENTE per il progressivo 23.3.2 in quanto offre un elettrodo della lunghezza di 70 mm anziché 50 mm come richiesto. Offre inoltre lo stesso dispositivo per i progressivi 2 e 4, 5 e 6, 8 e 9: non rientra, pertanto, nell'80% delle voci del sub lotto. Viene ritenuta NON IDONEA.

Il cavo risulta, inoltre, essere della lunghezza di 3 metri anziché 3,2 m come richiesto e pertanto troppo corto per le esigenze degli utilizzatori.

La ditta TAU MEDICA offre i primi 11 progressivi del sub lotto.

Risulta NON RISPONDENTE per il progressivo 2 in quanto offre un elettrodo della lunghezza di 70 mm anziché 50 come richiesto e per il progressivo 9 in quanto offre un elettrodo con terminale ad ago anziché a lama. Non rientra, pertanto, nell'idoneità dell'80% delle voci del sub lotto.

Le ditte FASE e FIAB offrono dispositivi RISPONDENTI al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
-------	--	--	---	--------

*Spina D.A. cl. H*

	tecnica)		
FASE	25	23	22
FIAB	25	23	22
			70 PUNTI
			70 PUNTI

**SUB LOTTO 23.4**

**LARINGOSCOPIO MONOUSO A LUCE FREDDA(FIBRA OTTICA)**

**SUB LOTTO 23.4.1 MANICO STANDARD CON LAMA MACINTOSH MISURA 2**

**SUB LOTTO 23.4.2 MANICO STANDARD CON LAMA MACINTOSH MISURA 3**

**SUB LOTTO 23.4.3 MANICO STANDARD CON LAMA MACINTOSH MISURA 4**

Presentano offerta le ditte COVIDIEN e TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta TELEFLEX viene ritenuto NON IDONEO in quanto non costituito da un unico pezzo non articolato.

Il dispositivo offerto dalla ditta COVIDIEN risulta rispondente a quanto richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Atraumaticità(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima atraumaticità su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	18	18	17	17	17	70 PUNTI

*Spun! Dr. R.A. Cui*

**LOTTO 24**

**SISTEMA PER IL CONDIZIONAMENTO TERMICO AD ARIA FORZATA COSTITUTO DA COPERTINA MONOPAZIENTE ED UNITA' RISCALDANTE COMPLETA DI CARRELLO**

**SUB LOTTO 24.1 COPERTINA ADULTI INTERO CORPO**

**SUB LOTTO 24.2 COPERTINA ADULTI META' CORPO INFERIORE**

**SUB LOTTO 24.3 COPERTINA ADULTI META' CORPO SUPERIORE**

**SUB LOTTO 24.4 COPERTINA BAMBINO INTERO CORPO**

**SUB LOTTO 24.5 COPERTINA BAMBINO META' CORPO INFERIORE**

**SUB LOTTO 24.6 COPERTINA BAMBINO META' CORPO SUPERIORE**

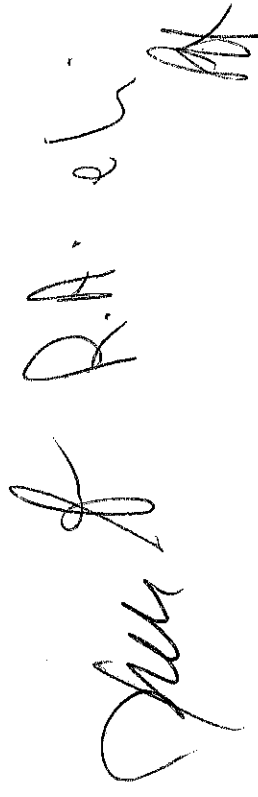
Presentano offerta le seguenti ditte: CAIR ITALIA, COVIDIEN, MOVI, SMITHS MEDICAL, 3M.

La ditta COVIDIEN viene ESCLUSA DALLA VALUTAZIONE in quanto non presenta documentazione tecnica relativa all'unità riscaldante.

Le rimanenti ditte offrono dispositivi RISPONDENTI al richiesto.

La ditta SMITHS MEDICAL non offre il progressivo 24.5 mentre le altre ditte offrono tutti i progressivi.

I punteggi assegnati sono i seguenti:



	CAIR ITALIA	MOVI	SMITHS MEDICAL	3M
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	17	12,75	17	17
Impostazioni di diverse temperature di funzionamento e di regolazione del flusso d'aria	6	12	12	12
Silenziosità del sistema(in decibel) valutato da scheda tecnica	0	6,3	7	5,95
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	15,72	16,15	16,15	15,17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	17	17	17	17
<b>TOTALE</b>	<b>55,72 PUNTI</b>	<b>64,2 PUNTI</b>	<b>69,15 PUNTI</b>	<b>67,12 PUNTI</b>

Le differenze di punteggio ottenute dalle ditte nel parametro ergonomia e maneggevolezza sono da imputarsi alle diverse dimensioni e peso dell'unità riscaldante riscontrate da documentazione tecnica.

Il dispositivo offerto dalla ditta MOVI presenta una minore resistenza allo strappo rispetto a quello delle altre ditte.

Le rimanenti differenze di punteggio sono scaturite dalle informazioni ricavate dalla documentazione tecnica.

## LOTTO 25

### SISTEMA PER IL RISCALDAMENTO DI SANGUE E LIQUIDI PER INFUSIONE

#### 1)SET MONOPAZIENTE

#### 2)UNITA' RISCALDANTE(uso gratuito)

Hanno presentato offerta le ditte CAIR ITALIA, CAREFUSION, SMITHS MEDICAL, 3M.

*Handwritten signature and initials: "F. R.A. C.L.M."*

La ditta MOVI viene dichiarata NON IDONEA in quanto il deflussore della linea paziente contiene ftalati e non è allegata dichiarazione di non rilascio; inoltre la stessa linea risulta della lunghezza di cm 150 mentre nel capitolato è richiesta una lunghezza superiore a 150cm.

Analogamente la ditta SMITHS MEDICAL viene considerata NON IDONEA in quanto il deflussore della linea paziente contiene ftalati e non è allegata dichiarazione di non rilascio.

La ditta CAREFUSION risulta NON IDONEA in quanto non si evince, dalla documentazione tecnica, la presenza dei sensori dell'allarme di bassa temperatura nel riscaldatore; la lunghezza del deflussore della linea paziente, inoltre, non risulta essere superiore a 150cm come richiesto.

Le ditte CAIR ITALIA e 3M offrono dispositivi RISPONDENTI al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

	CAIR ITALIA	3M
qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	18	18
Facilità di uso e di programmazione e di gestione	18	18
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	17	17
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	11,9	17
TOTALE	64,9 PUNTI	70 PUNTI

La differenza di punteggio raggiunta dalle ditte nel parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente è da attribuirsi per la ditta 3M alla presenza di allarme visivo e sonoro con spegnimento automatico alla temperatura di 46°C e per la ditta CAIR ITALIA all'assenza sulla documentazione tecnica di dati che permettano di evincere lo spegnimento automatico.

LOTTO 26

SISTEMI ELASTOMERICI

SUB LOTTO 26.1

SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, PORTATILE, STERILE, APIROGENO, MONOUSO

141

*R.A. e L. OK*  
*[Signature]*

SUB LOTTO 26.1.1 VOLUME NOMINALE DA 60 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 0,5ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.1.2 VOLUME NOMINALE DA 60 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.1.3 VOLUME NOMINALE DA 60 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1,5ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.1.4 VOLUME NOMINALE DA 60 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.1.5 VOLUME NOMINALE DA 60 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2,5ML/H CIRCA

Presentano offerta le ditte ADRIAMED, ALEA, ARCHIS, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MULTIMEDICAL, PACO, SURGIKA, TAU MEDICA, TSS MEDICAL.

Il dispositivo offerto dalla ditta ADRIAMED viene considerato NON IDONEO in quanto il reservoir non risulta protetto da involucri in materiale plastico.

La ditta ARCHIS offre lo stesso dispositivo per i progressivi 2 e 3 e per i progressivi 4 e 5: non rientra, pertanto, nell'80% delle voci del sub lotto e pertanto risulta NON IDONEA.

Le rimanenti ditte rispondono a tutti i progressivi del sub lotto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditte	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente costruttiva	TOTALE
ALEA	25	13	17	15	70 PUNTI
CORMED CARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
MULTIMEDICAL	25	13	17	15	70 PUNTI

*Luigi R.A.*

PACO	25	13	17	15	70 PUNTI
SURGIKA	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI
TSS MEDICAL	25	13	17	15	70 PUNTI

**SUB LOTTO 26.2**

**SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, PORTATILE, STERILE, APIROGENO, MONOUSO**

**SUB LOTTO 26.2.1 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 0,5ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.2 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.3 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1,5ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.4 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.5 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2,5ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.6 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 5ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.7 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 7ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.2.8 VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 10ML/H CIRCA**

Presentano offerta le ditte ALEA, ARCHIS, B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MULTIMEDICAL, PACO, SURGIKA, TAU MEDICA, TSS MEDICAL.

Handwritten signature and initials, possibly 'P.A. Cl. R.' and a large signature.

La ditta B.BRAUN viene ritenuta NON IDONEA in quanto il reservoir in elastomero non risulta protetto da un involucro rigido come richiesto.

Le rimanenti ditte offrono dispositivi idonei.

La ditta ARCHIS non risponde al progressivo 26.2.3 ma rientra nell'80% delle voci del sublotto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di programmazione e gestione	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALEA	25	13	17	15	70 PUNTI
ARCHIS	25	13	17	15	70 PUNTI
CORMED	25	13	17	15	70 PUNTI
CARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
MULTIMEDICAL	25	13	17	15	70 PUNTI
PACO	25	13	17	15	70 PUNTI
SURGICA	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI
TSS MEDICAL	25	13	17	15	70 PUNTI

SUB LOTTO 26.3

SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, PORTATILE, STERILE, APIROGENO, MONOUSO

SUB LOTTO 26.3.1 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1ML/H CIRCA

144

*Handwritten signature: R.A. el. H*



SUB LOTTO 26.3.2 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1,5ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.3.3 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2 ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.3.4 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2,5ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.3.5 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 5ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.3.6 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 7ML/H CIRCA

SUB LOTTO 26.3.7 VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 10ML/H CIRCA

Presentano offerta le ditte ALEA, ARCHIS, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MULTIMEDICAL, PACO, SURGIKA, TAU MEDICA, TSS MEDICAL.

La ditta ARCHIS offre tutti i progressivi del sub lotto ma è da ritenersi NON IDONEA in quanto presenta per i progressivi 1 e 4 dispositivi con volume nominale da 200 ml che non rientrano nella tolleranza del +/-15% e per i rimanenti progressivi dispositivi con volume nominale 300ml che analogamente non rientrano nella sopraindicata tolleranza.

La ditta CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE viene considerata NON IDONEA in quanto la documentazione tecnica presentata fa riferimento ad un dispositivo con volume nominale da 200ml anziché 250ml come richiesto: non rientra nella tolleranza del +/-15%.

Analogamente la ditta SURGIKA viene considerata NON IDONEA in quanto offre un dispositivo con volume nominale da 300ml che non rientra nella tolleranza indicata.

La ditta TAU MEDICA non risponde al progressivo 4 ma rientra nell'80% delle voci del sub lotto.

Le rimanenti ditte offrono tutti i progressivi del sub lotto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
-------	--	---	--	---	--------

*Handwritten signature and initials:*  
P... R.A. *eli*

	tecnica)				
ALEA	25	13	17	15	70 PUNTI
MULTIMEDICAL	25	13	17	15	70 PUNTI
PACO	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI
TSS MEDICAL	25	9,75	17	15	66,75 PUNTI

La ditta TSS raggiunge un punteggio inferiore nel parametro **precisione del flusso** in quanto dalla documentazione tecnica si evince una accuratezza del flusso di +/-15% a fronte del +/-10% dichiarato dalle altre ditte.

#### SUB LOTTO 26.4

**SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, PORTATILE, STERILE, APIROGENO, MONOUSO**

**SUB LOTTO 26.4.1 VOLUME NOMINALE DA 300 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1,5ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.4.2 VOLUME NOMINALE DA 300 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 2ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.4.3 VOLUME NOMINALE DA 300 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 7 ML/H CIRCA**

**SUB LOTTO 26.4.4 VOLUME NOMINALE DA 300 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 10ML/H CIRCA**

Presentano offerta le ditte ALEA, ARCHIS, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MULTIMEDICAL, PACO, SURGIKA, TAU MEDICA, TSS MEDICAL.

*Paolo R.A. el. PA*

La ditta PACO risulta NON IDONEA in quanto offre un dispositivo con volume nominale da 250ml che non rientra pertanto nel range previsto ossia 300ml.

Le rimanenti ditte offrono dispositivi rispondenti ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALEA	25	13	17	15	70 PUNTI
ARCHIS	25	13	17	15	70 PUNTI
CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
MULTIMEDICAL	25	13	17	15	70 PUNTI
SURGIKA	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI
TSS MEDICAL	25	9,75	17	15	66,75 PUNTI

La ditta TSS MEDICAL raggiunge un punteggio inferiore nel parametro **precisione del flusso** in quanto dalla documentazione tecnica si evince una accuratezza del flusso di +/-15% a fronte del +/-10% dichiarato dalle altre ditte.

SUB LOTTO 26.5

*Handwritten signatures and initials:*  
 D.A. ci  
 [Signature]  
 [Signature]

**SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, PORTATILE, STERILE, APIROGENO, MONOUSO**

**VELOCITA' DI INFUSIONE PER MEZZO DI MODULO DI REGOLAZIONE**

**SUB LOTTO 26.5.1 VOLUME NOMINALE DA 100 ML (TOLLERANZA +/-15%) CIRCA CON FLUSSO VARIABILE DA 1-2-3ML/H**

**SUB LOTTO 26.5.2 VOLUME NOMINALE DA 250 ML (TOLLERANZA +/-15%) CIRCA CON FLUSSO VARIABILE DA 2-3-5ML/H**

**SUB LOTTO 26.5.3 VOLUME NOMINALE DA 300 ML (TOLLERANZA +/-15%) CIRCA CON FLUSSO VARIABILE DA 2-3-5ML/H**

Presentano offerta le ditte ALEA, ARCHIS, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, SCOGNAMIGLIO, TSS MEDICAL.

Il dispositivo offerto dalla ditta CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE per il sub lotto 26.5.2 viene considerato NON RISPONDENTE in quanto il volume nominale risulta essere 200 ml anziché 250ml e pertanto non rientra nel range del 15%.

I dispositivi offerti per i sub lotti 26.5.1 e 26.5.3 sono ritenuti IDONEI.

I dispositivi offerti dalla ditta ARCHIS vengono ritenuti NON IDONEI in quanto permettono al paziente di interferire sull'erogazione variando autonomamente il flusso.

Il dispositivo offerto dalla ditta SCOGNAMIGLIO per il sub lotto 26.5.2 viene ritenuto non rispondente al richiesto in quanto presenta volume nominale 300 ml anziché 250 ml e pertanto non rientra nel range del 15%.


I dispositivi dei rimanenti sub lotti risultano rispondenti.

La ditta TSS MEDICAL offre lo stesso dispositivo per il sub lotto 2 e per il sub lotto 3: i dispositivi sono RISPONDENTI al richiesto.

I dispositivi offerti dalla ditta ALEA risultano RISPONDENTI al richiesto.

I punteggi assegnati sono i seguenti:

*Per la R.A. cl.*



ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
ALEA	25	13	17	15	70 PUNTI
CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
SCOGNAMIGLIO	25	13	17	15	70 PUNTI
TSS MEDICAL	25	10,4	4,25	10,5	50,15 PUNTI

La ditta TSS MEDICAL raggiunge un punteggio inferiore nel parametro **precisione del flusso** in quanto dalla documentazione tecnica si evince una accuratezza del flusso di +/-15% per i dispositivi con volume nominale da 275ml e di +/-10% per i dispositivi con volume nominale da 100ml a fronte del +/-10% dichiarato dalle altre ditte per tutti i volumi nominali.

Alla stessa ditta vengono attribuiti punteggi inferiori nel parametro **facilità di uso, programmazione e gestione** in quanto il meccanismo che blocca la regolazione del flusso non risulta di facile attivazione e nel parametro **qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente** in quanto il dispositivo che blocca la regolazione del flusso può essere facilmente manomesso dal paziente.

**SUB LOTTO 26.6**

**SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE DI TERAPIE PCA PER L'INFUSIONE DI FARMACI CON FLUSSI CONTINUI E BOLI.**

**PORTATILE, APIROGEO, STERILE.**

*Signature*  
*RA. 21*  
*Signature*

IL MODULO DI CONTROLLO DEL BOLO DEVE GARANTIRE DOSI DI BOLO CON VOLUME DA 0,5 ML/TEMPO A 2,0ML/TEMPO CON INTERVALLI DI BOLO DA 6 A 60 MINUTI.

VOLUME NOMINALE DA 60 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 0,5 ML/ORA A 10 ML/ORA CIRCA

Presentano offerta le ditte CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, SCOGNAMIGLIO, TAU MEDICA.

Viene ritenuto IDONEO per la ditta SCOGNAMIGLIO il dispositivo contraddistinto dal ref P0515S.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CORMED CARDIOVASCOLARE CARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
SCOGNAMIGLIO	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI

SUB LOTTO 26.7

SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE DI TERAPIE PCA PER L'INFUSIONE DI FARMACI CON FLUSSI CONTINUI E BOLI.

150

*per R.A. G.L.*

PORTATILE, APIROGEO, STERILE.

IL MODULO DI CONTROLLO DEL BOLO DEVE GARANTIRE DOSI DI BOLO CON VOLUME DA 0,5 ML/TEMPO A 2,0ML/TEMPO CON INTERVALLI DI BOLO DA 6 A 60 MINUTI.

VOLUME NOMINALE DA 100 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 0,5 ML/ORA A 10 ML/ORA CIRCA

Presentano offerta le ditte CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, SCOGNAMIGLIO, TAU MEDICA.

I dispositivi offerti sono RISPONDENTI al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CORMED CARDIOVASCOLARE CARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
SCOGNAMIGLIO	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI

SUB LOTTO 26.8

SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE DI TERAPIE PCA PER L'INFUSIONE DI FARMACI CON FLUSSI CONTINUI E BOLI.

*Handwritten signature: "P. A. di R. A. di"*

PORTATILE, APIROGEO, STERILE.

IL MODULO DI CONTROLLO DEL BOLO DEVE GARANTIRE DOSI DI BOLO CON VOLUME DA 0,5 ML/TEMPO A 2,0ML/TEMPO CON INTERVALLI DI BOLO DA 6 A 60 MINUTI.

VOLUME NOMINALE DA 250 ML CIRCA CON FLUSSO NOMINALE DA 1 ML/ORA A 10 ML/ORA CIRCA

Presentano offerta le ditte CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, SCOGNAMIGLIO, TAU MEDICA.

I dispositivi offerti sono RISPONDENTI al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Precisione del flusso documentata da scheda tecnica rispetto al flusso nominale	Facilità di uso, programmazione e gestione	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
CORMED CARDIOVASCOLARE CARDIOVASCOLARE	25	13	17	15	70 PUNTI
SCOGNAMIGLIO	25	13	17	15	70 PUNTI
TAU MEDICA	25	13	17	15	70 PUNTI

*Fu de R.A. ely*



### LOTTO 27 LINEA PER CAPNOMETRO

Presentano offerta le ditte CHIRURMEDICA, COVIDIEN, DRAGER.

La ditta CHIRURMEDICA offre un dispositivo della lunghezza di 3 metri e pertanto NON IDONEO per le esigenze degli utilizzatori.

Le rimanenti ditte offrono un dispositivo IDONEO e i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE
COVIDIEN	25	23	22	70 PUNTI
DRAGER	25	23	22	70 PUNTI

### LOTTO 28 KIT PER LA DECONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO DI BRONCO-ASPIRAZIONE

Presenta offerta la ditta CAIR ITALIA.

I dispositivi campionati sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e	Qualità correlata ad aspetti di	TOTALE
-------	---	---	---------------------------------	--------

	maggior corrispondenza della massima qualit� e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	maneggevolezza	sicurezza per il paziente	
CAIR ITALIA	25	23	22	70 PUNTI

### LOTTO 29 SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA NARCOSI

SUB LOTTO 29.1 SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA NARCOSI MONOLATERALI PEDIATRICI

SUB LOTTO 29.2 SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA NARCOSI MONOLATERALI ADULTI

SUB LOTTO 29.3 SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA NARCOSI BILATERALI ADULTI

Presentano offerta le ditte COVIDIEN e MASIMO.

La ditta MASIMO presenta offerta solamente per il sub lotto 29.1.3 e pertanto non rientra nell'80% delle voci del sub lotto: viene pertanto ritenuta NON IDONEA.

La ditta COVIDIEN presenta offerta per tutti e tre i sub lotti.

I dispositivi sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato   il seguente:

I dispositivi campionati sono rispondenti al richiesto ed il punteggio assegnato   il seguente:

ditta	qualit� e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualit� e resistenza su	Qualit� costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualit� correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	TOTALE

*Luca A. S. P.A. el M*

	valutazione della Commissione tecnica)		
COVIDIEN	25	23	70 PUNTI

**LOTTO 30 CATETERE PER INCANNULAMENTO ARTERIOSO**

Presenta offerta la ditta ALFAMED.

Il dispositivo offerto risulta essere in materiale PEBAX pertanto non rispondente al richiesto ossia poliuretano o polietilene: dalla documentazione tecnica non si evince dichiarazione di equivalenza prestazionale.

Il dispositivo risulta inoltre NON RISPONDENTE al richiesto in quanto non permette la manovra completa con una sola mano.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**LOTTO 31 SISTEMA PNEUMATICO PER LA PREVENZIONE DELLA STASI VENOSA NEL PAZIENTE IMMOBILE(GAMBALI E PLANTARI)**

Presentano offerta le ditte ARJOHUNTLEIGH, COVIDIEN, MOVI.

I dispositivi offerti sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

ditta	qualità e resistenza del materiale e della manifattura(coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	costruttiva aspetti di	TOTALE

*Mu S. R.A. & light*

	valutazione della Commissione tecnica)			
ARJOHUNTLEIGH	25	23	22	70 PUNTI
COVIDIEN	17,5	16,1	22	55,6 PUNTI
MOVI	21,25	16,1	22	59,35

La differenza di punteggio raggiunta dalle ditte nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura va attribuita all' elasticità e traspirabilità del materiale costituente, mentre per quanto riguarda il parametro qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza la differenza di punteggio è da ricercarsi nel maggior numero di punti di aggancio del gambale che permettono di seguire in maniera perfetta l'anatomia della gamba.

#### **LOTTO 32 KIT PER BLOCCHI NERVOSI CONTINUI**

SUB LOTTO 32.1 LUNGHEZZA 35MM CIRCA CON AGO 21G CIRCA

SUB LOTTO 32.2 LUNGHEZZA 50MM CIRCA CON AGO 21G CIRCA

SUB LOTTO 32.3 LUNGHEZZA 85MM CIRCA CON AGO 21G CIRCA

SUB LOTTO 32.4 LUNGHEZZA 120MM CIRCA CON AGO 19G CIRCA

#### **SUB LOTTO 32.1 LUNGHEZZA 35MM CIRCA CON AGO 21G CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, TELEFLEX.

I dispositivi presentati dalle ditte non rientrano, come misure, nella tolleranza prevista ossia 5%.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*Handwritten signature: J. A. R. A. e. S. A.*

**SUB LOTTO 32.2 LUNGHEZZA 50MM CIRCA CON AGO 21G CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MOVI.

I dispositivi presentati dalle ditte non rientrano, come misure, nella tolleranza prevista ossia 5%.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 32.3 LUNGHEZZA 85MM CIRCA CON AGO 21G CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MOVI.

I dispositivi presentati dalle ditte non rientrano, come misure, nella tolleranza prevista ossia 5%.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

**SUB LOTTO 32.4 LUNGHEZZA 120MM CIRCA CON AGO 19G CIRCA**

Presentano offerta le ditte B.BRAUN, CORMED CARDIOVASCOLARECARDIOVASCOLARE, MOVI.

I dispositivi presentati dalle ditte non rientrano, come misure, nella tolleranza prevista ossia 5%.

**PER IL SUB LOTTO IN QUESTIONE, PERTANTO, NON CI SONO OFFERTE VALIDE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.**

*M. P.A. C.A.*